


OXIMAX[®] DS-100A Durasensor[®]


Adult Oxygen Sensor




English	3
Français	6
Deutsch	9
Nederlands	13
Italiano	16
Español	19
Svenska	22
Dansk	25
Norsk	28
Suomi	31
Português	34
Русский	37
中文	41
Polski	44
Česky	47
Slovenian	50
Magyar	53
Ελληνικά	56
Türkçe	59

www.DataSheet4U.com

1

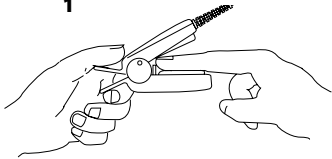


2




www.DataSheet4U.com

3



4



www.DataSheet4U.com

**OxiMAX®
DS-100A Durasensor**

Adult Oxygen Sensor

Rx ONLY**Directions for Use**

Indications/Contraindications

The Nellcor® Durasensor® adult oxygen sensor, model DS-100A, is indicated for use when continuous noninvasive arterial oxygen saturation and pulse rate monitoring are required for patients weighing greater than 40 kg.

The DS-100A is contraindicated for use on active patients or for prolonged use. It is not designed for long-term monitoring. It must be moved every 4 hours (or more often, if indicated by circulatory status and/or skin integrity) and reapplied to a different site. If long-term monitoring is required, use an OxiMAX oxygen sensor (MAX-A, MAX-AL, or MAX-N) or an Oxisensor II® sensor (D-25, D-25L, or N-25), depending on patient age and size, and instrument compatibility.

Instructions for Use

Use this sensor only with Nellcor instruments and instruments containing Nellcor oximetry, or with instruments licensed to use Nellcor sensors (Nellcor-compatible instruments). This sensor integrates Nellcor OxiMAX® technology into its design. When connected to an OxiMAX-enabled instrument, this sensor uses OxiMAX technology to provide additional advanced sensor performance features. Consult individual manufacturers for features and compatibility of particular instruments and sensor models.

Reusable sensors may be used on the same site for a maximum of 4 hours, provided the site is inspected routinely to ensure skin integrity and correct positioning. Because individual skin condition affects the ability of the skin to tolerate sensor placement, it may be necessary to change the sensor site more frequently with some patients.

To apply the DS-100A:

1. Place an index finger over the sensor window of the DS-100A with the finger tip against the stop. **(1)**
2. If the fingernail is long, the nail tip will extend over the finger stop. **(2)**

3. Spread open the rear tabs of the sensor to provide even force over the length of the pads. Check the position of the sensor. If an index finger cannot be positioned correctly, or is not available, a smaller finger can be used, or use an OxIMax or an Oxisensor II oxygen sensor. Do not use the DS-100A on a thumb or toe or across a child's hand or foot. **(3)**

Note: When selecting a sensor site, priority should be given to an extremity free of an arterial catheter, blood pressure cuff, or intravascular infusion line.

4. The sensor should be oriented in such a way that the cable is positioned along the top of the hand. **(4)**
5. Plug the DS-100A into the oximeter and verify proper operation as described in the oximeter operator's manual.

Note: If the sensor does not track the pulse reliably, it may be incorrectly positioned—or the sensor site may be too thick, thin, or deeply pigmented, or otherwise deeply colored (for example, as a result of externally applied coloring such as nail polish, dye, or pigmented cream) to permit appropriate light transmission. If any of these situations occurs, reposition the sensor or choose an alternate Nellcor sensor for use on a different site.

Cleaning

The DS-100A may be surface-cleaned by wiping it with a solution such as 70% isopropyl alcohol. If low-level disinfection is required, use a 1:10 bleach solution. Do not use undiluted bleach (5%~5.25% sodium hypochlorite) or any cleaning solution other than those recommended here because permanent damage to the sensor could occur.

CAUTION: Do not expose connector pins to cleaning solution as this may damage the sensor.

To clean or disinfect the sensor:

1. Saturate a clean, dry gauze pad with the cleaning solution. Wipe all surfaces of the sensor and cable with this gauze pad.
2. Saturate another clean, dry gauze pad with sterile or distilled water. Wipe all surfaces of the sensor and cable with this gauze pad.
3. Dry the sensor and cable by wiping all surfaces with a clean, dry gauze pad.

CAUTIONS

1. Do not sterilize by irradiation, steam, or ethylene oxide. Such sterilization could damage the sensor.
2. Failure to apply the DS-100A properly may cause incorrect measurements.
3. Using the DS-100A in the presence of bright lights may result in inaccurate measurements. In such cases, cover the sensor site with an opaque material.
4. Reusable sensors must be moved to a new site at least every 4 hours. Because individual skin condition affects the ability of the skin to tolerate sensor placement, it may be necessary to change the sensor site more frequently with some patients. If skin integrity changes, move the sensor to another site.

5. Intravascular dyes or externally applied coloring such as nail polish, dye, or pigmented cream, may lead to inaccurate measurements.
6. The performance of the DS-100A is compromised by motion.
7. Do not apply tape to secure the sensor in place or to tape it shut; venous pulsations may lead to inaccurate saturation measurements.
8. As with all medical equipment, carefully route cables to reduce the possibility of patient entanglement or strangulation.
9. Do not use the DS-100A or other oximetry sensors during MRI scanning. Conducted current may cause burns. Also, the DS-100A may affect the MRI image, and the MRI unit may affect the accuracy of oximetry measurements.
10. Do not alter or modify the DS-100A. Alterations or modifications may affect performance or accuracy.

If you have questions regarding any of this information, contact Nellcor's Technical Services Department, or your local Nellcor representative.

Warranty

To obtain information about a warranty, if any, for this product, contact Nellcor's Technical Services Department, or your local Nellcor representative.

Accuracy Specifications

For the accuracy specification range when used with Nellcor monitors, refer to information provided with the monitor, or (in the U.S.), contact Nellcor's Technical Services Department. Outside the U.S., contact your local Nellcor representative.

For the accuracy specification range when used with a monitor other than those manufactured by Nellcor, consult the information provided by the manufacturer of that instrument.

Note: Refer to the instrument operator's manual for complete instructions for use of the sensor with that monitor.

This sensor is sold under the following U.S. Patents and foreign equivalents: 6,708,049; 6,591,123; and 4,685,464.

© 2005 Nellcor Puritan Bennett Inc. All rights reserved.

OxiMAX® DS-100A Durasensor

Capteur à oxygène pour adulte

Mode d'emploi

Indications/Contre-indications

Le capteur à oxygène Nellcor Durasensor pour adulte, modèle DS-100A, est indiqué pour le monitoring en continu non invasif de la saturation artérielle en oxygène et du rythme cardiaque chez des patients pesant plus de 40 kg.

Le DS-100A est contre-indiqué chez des patients actifs ou dans le cas d'un usage prolongé. Il n'est pas conçu pour un monitoring à long terme. Il doit être déplacé toutes les 4 heures (ou plus souvent, si l'état circulatoire ou l'aspect de la peau le requièrent) et réappliqué sur un site différent. Pour un monitoring à long terme, il convient d'utiliser un capteur à oxygène OxiMAX, modèle MAX-A, MAX-AL ou MAX-N ou un capteur à oxygène Oxisensor II, modèle D-25, D-25L ou N-25, en fonction de l'âge et de la taille du patient, ainsi que de la compatibilité des instruments.

www.DataSheet4U.com

Instructions d'utilisation

Utiliser ce capteur uniquement avec des instruments Nellcor et des instruments contenant le capteur d'oximétrie Nellcor ou avec des instruments agréés pour l'utilisation de capteurs Nellcor (des instruments compatibles Nellcor). Ce capteur intègre la technologie Nellcor OxiMAX®. Lorsqu'il est connecté à un instrument compatible OxiMAX, ce capteur utilise la technologie OxiMAX pour fournir des fonctions avancées de performance de capteur supplémentaires. Consulter les fabricants individuels concernant les fonctions d'instruments particuliers et leur éventuelle compatibilité avec des modèles de capteurs.

Les capteurs réutilisables peuvent être utilisés sur le même site pendant 4 heures au maximum, pour autant que le site soit vérifié régulièrement afin de s'assurer de l'aspect normal de la peau et du positionnement correct. Chaque individu tolérant de manière différente le capteur sur la peau, il peut s'avérer nécessaire de déplacer le capteur plus fréquemment chez certains patients.

Pose du capteur DS-100A :

1. Placer l'index sur la fenêtre du capteur DS-100A en veillant à ce que l'extrémité du doigt se trouve contre le butoir. **(1)**
2. Si l'ongle est long, il doit passer au-dessus du butoir. **(2)**

3. Bien écarter les mâchoires arrière du capteur afin de répartir la pression sur toute la longueur des coussinets. Vérifier la position du capteur. Si l'index ne peut être positionné correctement, ou s'il ne peut être utilisé, il est possible de recourir à un autre doigt ou d'utiliser un capteur à oxygène OxiMAX ou Oxisensor II. Ne pas utiliser le DS-100A sur le pouce ou l'orteil, ou encore sur la main ou le pied d'un enfant. **(3)**

Remarque : Le capteur doit être positionné de préférence sur un membre ne portant ni cathéter artériel, ni brassard de prise de tension, ni voie de perfusion intravasculaire.

4. Le capteur doit être positionné de manière à ce que le câble se trouve dans le prolongement de la main. **(4)**
5. Brancher le raccord du DS-100A dans l'oxymètre comme décrit dans le manuel d'utilisation.

Remarque : Si le capteur ne peut détecter le pouls de manière fiable, cela indique qu'il est probablement mal positionné, ou que le site du capteur est trop épais, trop fin, trop profondément pigmenté ou encore trop profondément coloré (par exemple à la suite d'une application de couleur externe telle que du vernis à ongles, un colorant ou une crème pigmentée) pour permettre une transmission correcte de la lumière. Dans ces cas, repositionner le capteur ou choisir un autre capteur Nellcor et l'appliquer sur un autre site.

Nettoyage

Le capteur DS-100A peut être nettoyé en surface en le frottant avec un produit comme l'alcool isopropylique à 70 %. Si une désinfection de bas niveau est requise, utiliser un agent de blanchiment dans un rapport de 1 à 10. Ne pas utiliser d'agent de blanchiment non dilué (hypochlorate de sodium à 5 % ~ 5,25 %) ni des produits de nettoyage autres que ceux recommandés, car ils pourraient irrémédiablement endommager le capteur.

ATTENTION : Ne pas exposer les broches de connecteur à une solution de nettoyage car cela pourrait endommager le capteur.

Pour nettoyer ou désinfecter le capteur :

1. Saturer un tampon de gaze propre et sec avec la solution de nettoyage. Essuyer toutes les surfaces du capteur et le câble avec ce tampon de gaze.
2. Saturer un autre tampon de gaze propre et sec avec de l'eau stérile ou distillée. Essuyer toutes les surfaces du capteur et le câble avec ce tampon de gaze.
3. Sécher le capteur et le câble en essuyant toutes les surfaces avec un tampon de gaze propre et sec.

ATTENTION

1. Ne pas stériliser par rayonnement, à la vapeur ou à l'oxyde d'éthylène. Une telle stérilisation pourrait endommager le capteur.
2. Une mauvaise application du DS-100A peut entraîner une **inexactitude** dans les mesures.

www.DataSheet4U.com

3. L'utilisation du DS-100A sous une lumière vive risque d'affecter la précision des mesures. Dans ce cas, couvrir le site du capteur avec un tissu opaque.
 4. Les capteurs réutilisables doivent être déplacés sur un nouveau site toutes les 4 heures au moins. Chaque individu tolérant de manière différente le capteur sur la peau, il peut s'avérer nécessaire de déplacer le capteur plus fréquemment chez certains patients. Si l'aspect de la peau change, déplacer le capteur sur un autre site.
 5. La présence de colorants intravasculaires ou d'une application de couleur externe telle que du vernis à ongles, un colorant ou une crème pigmentée, peut affecter l'exactitude des mesures.
 6. La performance du DS-100A est compromise en cas de mouvement.
 7. Ne pas utiliser de bande adhésive pour maintenir le capteur en place et ne pas trop serrer la bande car les pulsations veineuses peuvent entraîner une inexactitude dans les mesures de saturation.
 8. Disposer soigneusement les câbles pour minimiser les risques de formation de nœuds ou d'enroulement autour du patient.
 9. Ne pas utiliser le DS-100A ou d'autres capteurs d'oxymétrie pendant une exploration par IRM. Le courant de conduction peut provoquer des brûlures. Le DS-100A peut altérer la qualité de l'image et l'unité IRM peut affecter la précision des mesures de l'oxymètre.
 10. Ne pas adapter ou modifier le DS-100A ; cela pourrait affecter les résultats ou la précision.
- Pour toutes questions éventuelles concernant les informations ci-dessus, prendre contact avec le Service technique Nellcor ou avec le représentant local Nellcor.

Garantie

Pour obtenir des informations concernant la garantie éventuelle couvrant ce produit, prendre contact avec le Service technique Nellcor ou avec le représentant local Nellcor.

Spécifications relatives à la précision

Pour toutes spécifications concernant la précision du capteur en cas d'utilisation avec les moniteurs Nellcor, se reporter aux informations fournies avec le moniteur ou prendre contact avec le Service technique Nellcor (aux États-Unis). Pour les autres pays, prendre contact avec le représentant Nellcor local.

Pour toutes spécifications concernant la précision du capteur en cas d'utilisation avec un moniteur autre que Nellcor, se reporter aux informations fournies par le fabricant de l'appareil.

Remarque : Se reporter au manuel d'utilisation de l'appareil pour obtenir les instructions d'utilisation complètes du capteur avec le moniteur concerné.

Ce capteur est vendu sous les brevets nord-américains suivants, et leurs équivalents étrangers : 6 708 049, 6 591 123 et 4 685 464.

OxiMAX® DS-100A Durasensor

Sauerstoffsättigungssensor für Erwachsene

Gebrauchsanweisung

Indikationen/Kontraindikationen

Der Sensor Nellcor Durasensor für Erwachsene, Modell DS-100A, ist für die kontinuierliche, nichtinvasive Überwachung der arteriellen Sauerstoffsättigung und der Pulsfrequenz bei Patienten mit einem Gewicht über 40 kg vorgesehen.

Eine Kontraindikation besteht beim DS-100A Sensor für aktive Patienten und bei längerer Anwendung. Der Sensor ist nicht für eine Langzeitüberwachung vorgesehen. Er muss alle 4 Stunden (oder öfter, wenn dies aufgrund der Blutzirkulation und/oder des Hautzustands erforderlich ist) abgenommen und an anderer Stelle wieder angelegt werden. Für eine Langzeitüberwachung ist abhängig von Alter und Größe des Patienten sowie von der Gerätekompatibilität ein OxiMAX-Sauerstoffsensor (MAX-A, MAX-AL oder MAX-N) oder ein Oxisensor II Sensor (D-25, D-25L oder N-25) zu verwenden.

Anwendungshinweise

Dieser Sensor ist zur ausschließlichen Verwendung mit Nellcor Geräten bestimmt sowie mit Geräten, die Nellcor Oximetriekomponenten enthalten oder zur Verwendung mit Nellcor Sensoren (Nellcor-kompatiblen Geräten) zugelassen sind. In diesem Sensor ist die Nellcor OxiMAX® Technologie integriert. Wird er an ein OxiMAX-kompatibles Gerät angeschlossen, nutzt dieser Sensor die OxiMAX Technologie, um zusätzliche fortgeschrittene Sensorfunktionen zu bieten. Informationen zu den Funktionen und zur Kompatibilität einzelner Instrumente und Sensormodelle erhalten Sie bei dem jeweiligen Hersteller.

Wiederverwendbare Sensoren können maximal 4 Stunden an ein und derselben Messstelle verbleiben, vorausgesetzt dass regelmäßig die Hautbeschaffenheit, die korrekte Anbringung und der sichere Sitz des Sensors an der Messstelle kontrolliert wird. Da die Sensorverträglichkeit an der Messstelle von der individuellen Hautbeschaffenheit abhängig ist, kann es bei einigen Patienten erforderlich sein, die Messstelle häufiger zu wechseln.

Zum Anlegen des DS-100A Sensors:

1. Den Zeigefinger über das Sensorfenster des DS-100A legen, sodass die Fingerkuppe am Ende anliegt. **(1)**

www.DataSheet4U.com

2. Bei langen Fingernägeln ragt die Nagelspitze über den Finger-Anschlag hinaus. **(2)**
3. Die Sensorenden müssen am Angelpunkt etwas auseinanderstehen, sodass über die gesamte Länge der Auflagefläche ein gleichmäßiger Druck ausgeübt wird. Die Position des Sensors überprüfen. Wenn sich der Zeigefinger nicht richtig positionieren lässt oder nicht für die Messung benutzt werden kann, muss der Sensor an einem kleineren Finger angelegt oder die Messung mit einem OxIMax oder Oxisensor II Sauerstoffsensor durchgeführt werden. Den DS-100A Sensor nicht am Daumen, an einer Zehe oder, bei einem Kind, an der Hand bzw. am Fuß anbringen. **(3)**

Hinweis: Der Sensor sollte möglichst nicht an einem Körperteil angelegt werden, an dem sich bereits ein arterieller Katheter, eine Blutdruckmanschette oder eine Infusionsleitung befindet.

4. Der Sensor muss so angelegt werden, dass das Kabel auf dem Handrücken nach oben geführt wird. **(4)**
5. Den DS-100A Sensor gemäß der entsprechenden Gebrauchsanweisung am Oximeter anschließen und den ordnungsgemäßen Betrieb überprüfen.

Hinweis: Wenn der Sensor den Puls nicht zuverlässig erfasst, ist er eventuell nicht richtig angebracht oder das Gewebe ist an der Messstelle möglicherweise zu dick, zu dünn, zu stark pigmentiert oder anderweitig dunkel gefärbt (z.B. aufgrund äußerlich angebrachter Färbung durch Nagellack, Färbemittel oder Pigmentcreme) und damit nicht genügend lichtdurchlässig. Wenn dies der Fall ist, muss der Sensor neu positioniert oder ein anderer Nellcor-Sensor an einer anderen Stelle verwendet werden.

www.DataSheet4U.com

Reinigen

Die Oberfläche des DS100A kann mit einer Reinigungslösung wie etwa 70%igem Isopropylalkohol gereinigt werden. Wenn eine geringe Desinfektion erforderlich ist, eine 1:10 Bleichlösung verwenden. Keine unverdünnte Bleiche (wie etwa Natriumhypochlorit 5 % bis 5,25 %) oder eine andere als die hier empfohlene Reinigungslösung verwenden, da sonst bleibende Schäden am Sensor entstehen können.

VORSICHT: Die Anschlussstifte dürfen nicht mit der Reinigungslösung in Berührung kommen, da der Sensor hierdurch beschädigt werden kann.

Reinigung oder Desinfektion des Sensors:

1. Einen sauberen, trockenen Gazeballen mit der Reinigungslösung tränken. Alle Oberflächen des Sensors und des Kabels mit diesem Gazeballen abwischen.
2. Einen anderen sauberen, trockenen Gazeballen mit sterilem oder destilliertem Wasser tränken. Alle Oberflächen des Sensors und des Kabels mit diesem Gazeballen abwischen.
3. Den Sensor und das Kabel durch Abwischen aller Oberflächen mit einem sauberen, trockenen Gazeballen trocknen.

www.DataSheet4U.com

ACHTUNG

1. Nicht durch Bestrahlung, Dampf oder Ethylenoxid sterilisieren. Durch diese Art der Sterilisierung kann der Sensor beschädigt werden.
2. Ein nicht ordnungsgemäß angelegter DS-100A Sensor kann zu ungenauen Messergebnissen führen.
3. Bei starker Lichteinwirkung kann die Verwendung des DS-100A Sensors zu ungenauen Messergebnissen führen. In solchen Fällen ist die Messstelle mit lichtundurchlässigem Material abzudecken.
4. Bei wiederverwendbaren Sensoren muss die Messstelle mindestens alle 4 Stunden gewechselt werden. Da die Sensorverträglichkeit an der Messstelle von der individuellen Hautbeschaffenheit abhängig ist, kann es bei einigen Patienten erforderlich sein, die Messstelle häufiger zu wechseln. Wenn sich der Zustand der Haut verändert, ist eine andere Messstelle für den Sensor zu wählen.
5. Intravasculäre Farbstoffe oder äußerlich aufgetragene Färbungen durch Nagellack, Färbemittel oder Pigmentcreme können die Genauigkeit der Messergebnisse beeinträchtigen.
6. Die Leistung des DS-100A kann durch Bewegungen beeinträchtigt werden.
7. Den Sensor nicht mit Hilfe von Klebeband fixieren oder vollständig mit Klebeband abdecken; auftretende Venenpulse können zu ungenauen Messergebnissen führen.
8. Wie bei allen medizinischen Geräten sind die Verbindungskabel zum Patienten mit äußerster Sorgfalt so anzulegen, dass der Patient sich nicht mit ihnen verwickeln kann.
9. Den DS-100A Sensor oder andere Oxi-Sensoren nicht während der Kernspintomographie anwenden, da Leitungsströme Verbrennungen verursachen können. Außerdem kann der Sensor die Qualität der Kernspintomographie beeinflussen und der Tomograph die Genauigkeit der Oximetermessung stören.
10. Keine Änderungen oder Modifikationen am DS-100A Sensor vornehmen, da hierdurch die Leistungsfähigkeit oder Genauigkeit des Sensors beeinträchtigt werden kann.

Bei Fragen zu vorstehenden Informationen wenden Sie sich an den Technischen Dienst von Nellcor oder an Ihre örtliche Nellcor-Vertretung.

Garantie

Informationen über bestehende Garantien für dieses Produkt erhalten Sie beim Technischen Dienst von Nellcor oder Ihrer örtlichen Nellcor-Vertretung.

Technische Daten

Angaben über die Messgenauigkeit bei gemeinsamer Verwendung mit Nellcor-Monitoren sind den Informationen über den jeweiligen Monitor zu entnehmen oder bei der örtlichen Nellcor-Vertretung zu erfragen.

Angaben über die Messgenauigkeit bei Verwendung mit Monitoren anderer Hersteller als Nellcor sind den Geräteinformationen des jeweiligen Herstellers zu entnehmen.

Hinweis: Komplette Anweisungen für die Benutzung des Sensors mit einem Monitor sind der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Gerätes zu entnehmen.

Dieser Sensor wird unter folgenden US-Patenten und deren ausländischen Entsprechungen verkauft: 6,708,049; 6,591,123 und 4,685,464.

© 2005 Nellcor Puritan Bennett Inc. Alle Rechte vorbehalten.

www.DataSheet4U.com

www.DataSheet4U.com

**OxiMAX®
DS-100A Durasensor**

Pulsoxymetriesensor voor volwassenen

Gebruiksaanwijzing

Indicaties/contra-indicaties

De Durasensor pulsoxymetriesensor voor volwassenen van Nellcor, model DS-100A, wordt gebruikt bij continue, niet-invasieve bewaking van de arteriële zuurstofsaturatie en de puls frequentie bij patiënten met een gewicht van meer dan 40 kg.

Gebruik de DS-100A niet bij actieve patiënten of gedurende langere tijd. De sensor is niet bedoeld voor langdurige bewaking. Hij dient elke 4 uur (of vaker indien de bloedcirculatie en/of integriteit van de huid daar aanleiding toe geven) verwijderd te worden en op een andere plaats aangebracht te worden. Indien langdurige bewaking vereist is, dient u gebruik te maken van een OxiMAX pulsoxymetriesensor (MAX-A, MAX-AL of MAX-N) of een Oxisensor II sensor (D-25, D-25L of N-25), naar gelang van de leeftijd en het gewicht van de patiënt en de compatibiliteit van het instrument.

Gebruiksaanwijzing

Gebruik deze sensor alleen met Nellcor-instrumenten en instrumenten die Nellcor-oximetrie bevatten, of met instrumenten die gecertificeerd zijn voor gebruik met Nellcor-sensoren (Nellcor-compatibele instrumenten). In deze sensor is Nellcor OxiMAX® technologie in het ontwerp geïntegreerd. Als deze sensor is aangesloten op een instrument waarin OxiMAX is geïntegreerd, dan gebruikt dit instrument OxiMAX-technologie waarmee de sensor extra mogelijkheden biedt. Neem contact op met de desbetreffende fabrikanten voor de mogelijkheden en compatibiliteit van hun instrumenten en sensoren.

Sensoren die geschikt zijn voor hergebruik mogen maximaal 4 uur op dezelfde plaats gebruikt worden, op voorwaarde dat de sensorplaats regelmatig gecontroleerd wordt op de integriteit van de huid en een juiste positionering van de sensor. Omdat de mate waarin de sensor door de huid verdragen wordt, afhangt van de conditie van de huid, kan het bij sommige patiënten noodzakelijk zijn de sensor vaker te verplaatsen.

Aanbrengen van de DS-100A:

1. Plaats een wijsvinger op het sensorvenster van de DS-100A zodat de vingertop tegen het scharnierpunt aanligt. **(1)**

2. Bij lange vingernagels valt de nagelrand over het scharnierpunt heen. **(2)**
3. Spreid de uitsteeksel aan de scharnierkant van de sensor zodat de druk gelijkmatig over de sensorvlakken verdeeld wordt. Controleer de positie van de sensor. Als er geen wijsvinger beschikbaar is, of als deze niet op de juiste wijze in de sensor geplaatst kan worden, kan een kleinere vinger of een OxIMAX of Oxisensor II pulsoxymetriesensor gebruikt worden. De DS-100A mag niet op een duim of teen, of bij kleine kinderen op de hand of voet aangebracht worden. **(3)**

Opmerking: De sensor dient bij voorkeur bevestigd te worden op een lichaamsdeel waarop geen arteriële katheter, bloeddrukmanchet of intravasculaire infuuslijn is aangebracht.

4. Richt de sensor zodanig dat de kabel aan de bovenkant van de hand komt te liggen. **(4)**
5. Sluit de DS-100A op de pulsoxymeter aan en controleer of sensor en monitor goed werken zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing van de pulsoxymeter.

Opmerking: Als de sensor de puls niet op betrouwbare wijze detecteert, kan het zijn dat hij niet goed aangebracht is of dat de sensorplaats te dik, te dun, te sterk gepigmenteerd of om een andere reden (nagellak, kleurstof, gepigmenteerde crème enz.) te sterk gekleurd is voor een goede lichtdoorlating. In al deze gevallen dient u de sensor (of een andere Nellcor pulsoxymetriesensor) op een andere plaats aan te brengen.

Reinigen

Gebruik voor het reinigen van de DS-100A een oplossing van 70% isopropanol. Indien ontsmetting gewenst is, kunt u gebruik maken van een bleekmiddeloplossing in een verhouding van 1:10. Gebruik geen overdund bleekmiddel (5%~5,25% natriumhypochloriet) of andere dan de hier aanbevolen reinigungsoplossingen. Dit kan de sensor blijvend beschadigen.

LET OP: de connectorpinnen mogen niet in aanraking komen met reinigungsmiddelen omdat deze de sensor kunnen beschadigen.

De sensor kan als volgt gereinigd of gedesinfecteerd worden:

1. Doordrenk een schoon, droog gaasje met de reinigungsoplossing en reinig het gehele oppervlak van de sensor en de kabel.
2. Doordrenk een ander schoon, droog gaasje met steriel of gedestilleerd water en reinig het gehele oppervlak van de sensor en de kabel.
3. Droog het gehele oppervlak van de sensor en de kabel met een schoon, droog gaasje af.

LET OP

1. Niet steriliseren met behulp van bestraling, stoom of ethyleenoxide. Een dergelijke sterilisatie kan de sensor beschadigen.
2. Een verkeerd aangebrachte DS-100A kan tot onjuiste metingen leiden.
3. Gebruik van de DS-100A in een omgeving met felle lampen kan tot onnauwkeurige metingen leiden. In dat geval dient u de sensorplaats met ondoorzichtig materiaal te bedekken.

4. Sensoren die geschikt zijn voor hergebruik dienen minimaal om de 4 uur op een andere plaats aangebracht te worden. Omdat de mate waarin de sensor door de huid verdragen wordt, afhangt van de conditie van de huid, kan het bij sommige patiënten noodzakelijk zijn de sensor vaker te verplaatsen. Als de integriteit van de huid verandert, dient u de sensor op een andere plaats aan te brengen.
5. Intravasculaire kleurstoffen of uitwendig aangebrachte kleurstoffen, nagellak of gepigmenteerde crème kunnen tot onnauwkeurige metingen leiden.
6. Beweging heeft een nadelige invloed op de prestaties van de DS-100A.
7. Gebruik geen tape om de sensor op zijn plaats te houden of dicht te plakken; veneuze pulsaties kunnen tot onnauwkeurige saturatiemetingen leiden.
8. Zoals bij alle medische apparatuur dient u de kabels zorgvuldig te geleiden om te voorkomen dat de patiënt erin verstrikt raakt of erdoor gewurgd wordt.
9. De DS-100A of andere pulsoxymetriesensoren mogen niet gebruikt worden tijdens het maken van MR-scans. Een geïnduceerde stroom kan brandwonden veroorzaken. Bovendien kan de DS-100A de MR-scan beïnvloeden en kan de MRI-installatie de nauwkeurigheid van de pulsoxymetrie-metingen beïnvloeden.
10. De DS-100A mag niet aangepast of gewijzigd worden. Aanpassingen of wijzigingen kunnen de werking of de nauwkeurigheid nadelig beïnvloeden.

Bij vragen over deze informatie kunt u contact opnemen met Nellcor Technical Services of uw lokale Nellcor-vertegenwoordiger.

www.DataSheet4U.com

Garantie

Voor informatie over mogelijke garantiebepalingen voor dit product kunt u contact opnemen met Nellcor Technical Services of uw lokale Nellcor-vertegenwoordiger.

Technische gegevens

Voor gegevens over de meetnauwkeurigheid bij gebruik met Nellcor-monitoren dient u de informatie te raadplegen die bij de betreffende monitor geleverd wordt. U kunt ook contact opnemen met uw lokale Nellcor-vertegenwoordiger.

Voor gegevens over de meetnauwkeurigheid bij gebruik met een monitor van een ander merk dient u de informatie te raadplegen die door de fabrikant van het betreffende apparaat geleverd wordt.

Opmerking: Volledige instructies voor het gebruik van de sensor met een bepaalde monitor zijn opgenomen in de gebruiksaanwijzing van de monitor.

Deze sensor wordt onder de volgende Amerikaanse patenten en buitenlandse equivalenten verkocht: 6,708,049; 6,591,123 en 4,685,464.

© 2005 Nellcor Puritan Bennett Inc. Alle rechten voorbehouden.

www.DataSheet4U.com

OxiMAX® DS-100A Durasensor

Sensore d'ossigeno per adulti

Istruzioni per l'uso

Indicazioni e controindicazioni

Il sensore d'ossigeno per adulti Nellcor Durasensor, Modello DS-100A, va utilizzato su pazienti di peso superiore a 40 kg per il monitoraggio continuo e non invasivo della saturazione arteriosa d'ossigeno e della frequenza del polso.

Il DS-100A non è indicato per l'utilizzo con pazienti attivi e per monitoraggi di lunga durata. Dev'essere spostato ogni 4 ore (oppure più spesso, a seconda delle condizioni circolatorie e/o dell'integrità della pelle). Se è richiesto un monitoraggio di lunga durata, utilizzare sensori d'ossigeno OxiMAX (Modello MAX-A, MAX-AL o MAX-N) o Oxisensor II, (Modello D-25, D-25L o N-25), secondo l'età e la corporatura del paziente e la compatibilità dello strumento.

Istruzioni per l'uso

Questo sensore deve essere utilizzato solo con strumenti Nellcor o integranti il sistema di ossimetria Nellcor oppure con strumenti abilitati all'uso di sensori Nellcor (strumenti Nellcor compatibili). Questo sensore nel suo disegno integra la tecnologia Nellcor OxiMAX®. Quando collegato a uno strumento compatibile con il sistema OxiMAX, questo sensore utilizza la tecnologia OxiMAX per fornire al sensore funzioni avanzate aggiuntive. Contattare i singoli produttori per le caratteristiche e la compatibilità di particolari strumenti e modelli di sensore.

I sensori riutilizzabili non vanno lasciati nello stesso punto di applicazione per più di 4 ore, controllando periodicamente il corretto posizionamento, l'integrità della pelle e l'adesione della fascetta. Poiché la tolleranza della pelle al sensore può variare da paziente a paziente, può darsi che per alcuni risulti necessario spostarlo più frequentemente.

Applicazione del DS-100A

1. Appoggiare il dito indice alla finestrella del sensore DS-100A, con la punta appoggiata contro il fermo. **(1)**
2. Se l'unghia del paziente è lunga, può darsi che essa possa prolungarsi oltre il fermo. **(2)**

3. Aprire le linguette posteriori del sensore affinché la pressione esercitata risulti costante sull'intera lunghezza del sensore. Verificare il posizionamento del sensore. Se non lo si può posizionare correttamente o se risulta impossibile applicarlo sul dito indice, in alternativa si può utilizzare un altro dito della mano, oppure un sensore d'ossigeno OxIMAX o Oxisensor II. Non applicare il DS-100A al pollice, all'alluce, alla mano o al piede di un bambino. **(3)**

Nota: evitare di collocare il sensore ad un arto sul quale sia già stato applicato un catetere arterioso, un bracciale sfigmomanometrico o una linea di infusione intravascolare.

4. Il sensore va posizionato in modo che il cavo si trovi lungo il dorso della mano. **(4)**
5. Collegare il DS-100A al saturimetro e verificare che funzioni correttamente, come descritto nel relativo Manuale d'uso.

Nota: se il sensore non rileva un segnale affidabile di polso, è possibile che sia posizionato in modo errato, oppure che il punto di applicazione sia troppo spesso, sottile o pigmentato, o che su di esso sia stato applicato uno strato colorato esterno, ad esempio smalto, tintura o creme pigmentate, per consentire un'adeguata trasmissione della luce. Se si verifica una di queste condizioni, riposizionare il sensore o scegliere un sensore Nellcor alternativo e usarlo su un sito diverso.

Pulizia

Per pulire il sensore DS-100A, passarne le superfici con un panno imbevuto di una soluzione detergente quale alcool isopropilico al 70%. Per disinfettarlo superficialmente, utilizzare varechina 1:10. Non utilizzare candeggina non diluita (ipoclorito di sodio al 5%~5,25%) o altre soluzioni detergenti diverse da quelle raccomandate poiché potrebbero danneggiare il sensore in modo irreversibile.

ATTENZIONE: non esporre i pin del connettore alla soluzione detergente, per evitare di danneggiare il sensore.

Pulizia e disinfezione del sensore:

1. Passare tutte le superfici del sensore e del cavo con una garza pulita imbevuta di soluzione detergente.
2. Passare tutte le superfici del sensore e del cavo con un'altra garza pulita imbevuta di acqua sterile o distillata.
3. Asciugare il sensore e il cavo passandone tutte le superfici con una garza pulita e asciutta.

ATTENZIONE

1. Non sterilizzare per irradiazione, vapore oppure ossido di etilene, poiché questi metodi di sterilizzazione danneggiano il sensore.
2. Un'applicazione non corretta del sensore DS-100A può determinare misure imprecise.
3. La presenza di luce eccessiva potrebbe determinare misure imprecise. In tal caso, coprire il sensore con un panno.

4. Il punto di applicazione del sensore riutilizzabile va cambiato almeno ogni 4 ore. Poiché la tolleranza della pelle al sensore può variare da paziente a paziente, può darsi che per alcuni occorra spostarlo più frequentemente. In presenza di problemi alla cute, spostare immediatamente il sensore.
5. La presenza di coloranti intravascolari o di strati colorati esterni, ad esempio smalto, tintura o creme pigmentate, può dar luogo a errori di misura.
6. La prestazione del dispositivo DS-100A è compromessa dal movimento.
7. Non utilizzare cerotti per fissare il sensore o per tenerlo chiuso; le pulsazioni venose possono determinare misure di saturazione imprecise.
8. Come per tutte le apparecchiature medicali, collegare i cavi con la dovuta attenzione per evitare il rischio di strangolare o impigliare il paziente.
9. Non utilizzare l'DS-100A o altri sensori saturimetrici durante esami di risonanza magnetica. La corrente potrebbe infatti causare ustioni. Il DS-100A potrebbe inoltre influire sulla qualità dell'immagine, mentre l'unità MRI potrebbe influire a sua volta sulla precisione delle misure saturimetriche.
10. Non alterare o modificare l'DS-100A. Eventuali alterazioni o modifiche possono influire sulla qualità e sulla correttezza delle misure.

In caso di domande su queste informazioni, contattare il Servizio di Assistenza Tecnica Nellcor o il Distributore Nellcor locale.

Garanzia

www.DataSheet4U.com

Per informazioni sulle eventuali garanzie fornite con questo prodotto, contattare il Servizio di Assistenza Tecnica Nellcor o il Distributore Nellcor locale.

Precisione

Per le specifiche di precisione durante l'uso con monitor Nellcor, fare riferimento alle informazioni fornite con il monitor, oppure (negli Stati Uniti) contattare il Dipartimento di assistenza tecnica. Al di fuori degli Stati Uniti, rivolgersi al Distributore Nellcor di zona.

Per le caratteristiche di precisione durante l'uso con monitor non Nellcor, vedere le informazioni fornite dal relativo produttore.

Nota: Per istruzioni complete sull'uso del sensore con tale monitor, attenersi al relativo Manuale d'uso.

Questo sensore è protetto da uno o più dei seguenti brevetti U.S.A. ed equivalenti esteri: 6,708,049; 6,591,123 e 4,685,464.

© 2005 Nellcor Puritan Bennett Inc. Tutti i diritti riservati.

www.DataSheet4U.com

OxiMAX® DS-100A Durasensor

Sensor de oxígeno para adultos

Modo de empleo

Indicaciones y contraindicaciones

El sensor de oxígeno para adultos Durasensor de Nellcor modelo DS-100A está indicado para la vigilancia continua no invasiva de la saturación de oxígeno arterial y la frecuencia del pulso en pacientes de más de 40 kg de peso.

El DS-100A está contraindicado para pacientes activos o para usos prolongados. No está diseñado para la vigilancia durante largos períodos de tiempo. Debe moverse cada 4 horas (o más a menudo si así lo requiere el estado de la circulación o la integridad de la piel) y volverse a aplicar en un lugar diferente. Para la vigilancia durante largos períodos de tiempo, utilice un sensor de oxígeno OxiMAX (MAX-A, MAX-AL o MAX-N) o un sensor Oxisensor II (D-25, D-25L o N-25), dependiendo de la edad y el tamaño del paciente, y de la compatibilidad del instrumento.

www.DataSheet4U.com

Instrucciones de uso

Use este sensor sólo con instrumentos de Nellcor e instrumentos que contengan oximetría de Nellcor o con instrumentos autorizados para usarse con sensores de Nellcor (instrumentos compatibles con Nellcor). Este sensor integra la tecnología OxiMAX® de Nellcor en su diseño. Cuando se conecta a un instrumento que permite el uso de OxiMAX, este sensor usa la tecnología OxiMAX para proporcionar funciones avanzadas de rendimiento adicionales. Consulte a cada fabricante las características y la compatibilidad de cada modelo de sensor y cada instrumento.

Los sensores reutilizables pueden utilizarse en el mismo lugar durante un máximo de 4 horas, siempre que se compruebe periódicamente el lugar para garantizar la integridad de la piel y para corregir la posición. Debido a que el estado individual de la piel afecta a la capacidad de ésta para tolerar la colocación del sensor, con algunos pacientes puede ser necesario cambiar de lugar el sensor más frecuentemente.

Para aplicar el DS-100A:

1. Coloque el dedo índice sobre la ventana del sensor del DS-100A con la punta del dedo tocando el tope. **(1)**
2. Si la uña es muy larga, sobresaldrá del tope del dedo. **(2)**
3. Extienda y abra las pestañas posteriores del sensor para aplicar una fuerza uniforme sobre toda la longitud de las almohadillas. Compruebe la posición del sensor. Si no puede

www.DataSheet4U.com

colocarse correctamente el dedo índice, o éste no está disponible, puede utilizarse un dedo más pequeño, o utilizar un sensor de oxígeno OxI_{MAX} u Oxisensor II. No utilice el DS-100A en pulgares, en dedos del pie ni en manos o pies de niños. **(3)**

Nota: Cuando seleccione el lugar de colocación del sensor, debe darse prioridad a las extremidades en las que no haya colocados catéteres arteriales, manguitos de tensión arterial ni líneas de infusión intravascular.

4. Debe orientarse el sensor de tal forma que el cable quede colocado a lo largo de la parte superior de la mano. **(4)**
5. Conecte el DS-100A al oxímetro y compruebe que funciona correctamente, tal como se describe en el manual del usuario del mismo.

Nota: Si el sensor no sigue correctamente el pulso, puede estar mal colocado, o el emplazamiento del sensor puede ser demasiado estrecho, ancho o estar demasiado pigmentado o coloreado (por ejemplo, debido a la aplicación externa de coloración tal como laca de uñas, tinte o crema pigmentada) como para permitir la transmisión apropiada de luz. Si ocurre alguna de estas situaciones, vuelva a colocar el sensor o elija otro sensor Nellcor y utilícelo en un lugar diferente.

Limpieza

La superficie del DS-100A puede limpiarse frotándola con una solución tal como alcohol isopropílico al 70 %. Si se requiere una desinfección de bajo nivel, utilice una solución de lejía reducida en proporción 1:10. No utilice lejía sin diluir (hipoclorito de sodio del 5 al 5,25 %) ni ninguna otra solución de limpieza aparte de las recomendadas aquí, ya que podrían ocasionar daños permanentes en el sensor.

AVISO: No exponga los conectores de contacto a la solución de limpieza, pues se podría dañar el sensor.

Para limpiar o desinfectar el sensor:

1. Impregne una almohadilla de gasa limpia y seca con la solución de limpieza, y frote con ella todas las superficies del sensor y del cable.
2. Impregne otra almohadilla de gasa limpia y seca con agua esterilizada o destilada, y frote con ella todas las superficies del sensor y del cable.
3. Seque el sensor y el cable frotando todas las superficies con una almohadilla de gasa limpia y seca.

PRECAUCIÓN

1. No esterilice mediante radiación, vapor u óxido de etileno. Este tipo de esterilización podría dañar al sensor.
2. La aplicación incorrecta del DS-100A puede dar lugar a mediciones incorrectas.
3. Si utiliza el DS-100A en presencia de luces brillantes las mediciones puede ser imprecisas. En tales casos, cubra el sensor con un material opaco.

www.DataSheet4U.com

- Los sensores reutilizables deben cambiarse de lugar al menos cada 4 horas. Debido a que el estado particular en que se encuentre la piel puede afectar a la capacidad de ésta para tolerar la colocación del sensor, en algunos pacientes puede ser necesario cambiar de lugar el sensor más frecuentemente. Si cambia la integridad de la piel, cambie de lugar el sensor.
- Los colorantes intravasculares y la coloración aplicada externamente, tal como laca de uñas, colorante o crema pigmentada, pueden dar lugar a mediciones incorrectas.
- El rendimiento del sistema DS-100A se ve afectado por el movimiento.
- No utilice esparadrapo para fijar el sensor a su lugar ni para cubrirlo totalmente; las pulsaciones venosas pueden dar lugar a mediciones de saturación incorrectas.
- Al igual que con todo el equipo médico, oriente cuidadosamente los cables para reducir la posibilidad de enredo o de estrangulamiento del paciente.
- No utilice el DS-100A ni otros sensores de oximetría durante escáneres de resonancia magnética. La corriente eléctrica puede producir quemaduras. Además, el DS-100A puede afectar a la imagen de la resonancia magnética, y la unidad de resonancia magnética puede afectar a la precisión de las mediciones de oximetría.
- No altere ni modifique el DS-100A. Las alteraciones o modificaciones pueden afectar al rendimiento o a la precisión.

Si tiene alguna pregunta acerca de esta información, póngase en contacto con el Departamento de Servicio Técnico de Nellcor o con su representante local de Nellcor.

Garantía

www.DataSheet4U.com

Para obtener información acerca de la garantía de este producto, si la tuviera, póngase en contacto con el Departamento de Servicio Técnico de Nellcor o con su representante local de Nellcor.

Especificaciones de la precisión

Si desea conocer el rango de las especificaciones de precisión de este sensor cuando se utilice con monitores Nellcor, consulte la información proporcionada con el monitor o (en EE.UU.) póngase en contacto con el Departamento de Servicio Técnico de Nellcor. Desde fuera de EE.UU., póngase en contacto con su representante local de Nellcor.

Si desea conocer el rango de las especificaciones de precisión de este sensor cuando se utilice con monitores no fabricados por Nellcor, consulte la información proporcionada por el fabricante del instrumento particular.

Nota: Consulte el manual de usuario del instrumento si desea obtener instrucciones completas del uso del sensor con dicho instrumento.

Este sensor se vende bajo las siguientes patentes de EE.UU. y los equivalentes de otros países: 6.708.049; 6.591.123 y 4.685.464.

© 2005 Nellcor Puritan Bennett Inc. Reservados todos los derechos.

www.DataSheet4U.com

OxiMAX® DS-100A Durasensor

Syresensor för vuxna

Bruksanvisning

Indikationer/Kontraindikationer

Nellcor Durasensor, syresensor för vuxna, modell DS-100A, är indikerad för användning vid kontinuerlig, icke-invasiv arteriell övervakning av syremättnad och pulsfrekvens för patienter som väger mer än 40kg.

DS-100A är kontraindikerad för användning på aktiva patienter eller för långvarig användning. Den är inte avsedd för övervakning under lång tid. Den måste flyttas var fjärde timme (eller oftare, om så indikeras av cirkulations- eller hudstatus) och placeras på ett nytt ställe. Om övervakning under lång tid krävs, bör en OxiMAX syresensor (MAX-A, MAX-AL, eller MAX-N) eller en Oxisensor II sensor (D-25, D-25L, eller N-25) användas, beroende på patientens ålder och storlek, samt instrumentkompatibilitet.

Bruksanvisning

Använd denna sensor endast med Nellcor-instrument och instrument med Nellcor-oximetrikomponenter eller med instrument som är licensierade för Nellcor-sensorer (Nellcor-kompatibla instrument). Nellcor OxiMAX®-teknologi ingår i denna sensors design. När denna sensor är ansluten till ett OxiMAX-aktiverat instrument, använder sensorn OxiMAX-teknologi för att tillhandahålla ytterligare avancerade sensorfunktioner. Kontakta respektive tillverkare för de enskilda instrumentens funktioner och kompatibilitet med olika sensormodeller.

Sensorer för återanvändning kan användas på samma ställe under högst fyra timmar, förutsatt att stället inspekteras med jämna mellanrum för att säkerställa hudstatus och korrekt placering. På grund av att individuell hudkänslighet påverkar förmågan att tolerera placering av sensorn, kan det bli nödvändigt att byta ställe oftare på en del patienter.

Applikation av DS-100A:

1. Placera ett pekfinger över sensorfönstret på DS-100A med fingertoppen mot stoppet. **(1)**
2. Om nageln är lång, kommer nageln att sticka ut över stoppet. **(2)**

3. Vik ut sensorns bakre flikar för att fördela kraften jämt över längden på dynorna . Kontrollera sensorns placering. Om ett pekfinger inte kan placeras korrekt, eller om det inte finns tillgängligt, kan ett mindre finger användas. En OxiMAX eller en Oxisensor II kan också användas. Använd inte DS-100A på en tumme, tå eller över ett barns hand eller fot. **(3)**
- OBS!** När appliceringsställe väljs skall man välja en kroppsdel som är fri från arteriell kateter, tryckmanschett, eller intravaskulär infusions slang.
4. Sensorn skall riktas så att kabeln placeras utmed toppen av handen. **(4)**
 5. Koppla in DS-100A till oximetern samt kontrollera korrekt drift enligt beskrivning i oximeterns bruksanvisning.
- OBS!** Om sensorn inte följer pulsen pålitligt, kan den vara felaktigt placerad, eller så kan appliceringsstället vara för tjockt, tunt, eller mörkt färgad (till exempel som ett resultat av yttre pålagd färg som nagellack, färg eller färgad kräm) för att ge korrekt ljusöverföring. Om någon av dessa situationer uppstår, skall sensorn placeras om eller så skall en annan Nellcorsensor väljas för användning på ett annat appliceringsställe.

Rengöring

DS-100A kan rengöras ytligt genom att torka av med en lösning som till exempel 70% isopropylalkohol. Om desinfektion på låg nivå krävs, skall en blekmedelslösning (1:10) användas. Använd inte utspätt blekmedel (5%~5,25% natriumhypoklorit) eller andra rengöringsmedel än de som rekommenderas här, eftersom sensorn kan skadas permanent.

OBS! Rengör inte kontaktstiften med rengöringslösningar, eftersom det kan skada sensorn.

För att rengöra eller desinficera sensorn:

1. Dränk in en ren och torr sudd med rengöringslösningen. Torka av alla ytor på sensorn samt kabeln med sudd.
2. Dränk in ytterligare en ren och torr sudd med sterilt eller destillerat vatten. Torka av alla ytor på sensorn samt kabeln med sudd.
3. Torka sensorn och kabeln genom att torka alla ytor med en ren och torr sudd.

VAR FÖRSIKTIG!

1. Får ej steriliseras med strålning, ånga eller etylenoxid. Sådana steriliseringsmetoder kan skada sensorn.
2. Om inte DS-100A appliceras korrekt kan detta orsaka felaktiga mätningar.
3. Om DS-100A används i starkt ljus kan detta orsaka felaktiga mätningar. Täck under sådana omständigheter över sensorn med ett ogenomskinligt material.
4. Sensorer för återanvändning måste flyttas till en nytt ställe åtminstone var fjärde timme. På grund av att individuell hudkänslighet påverkar förmågan att tolerera placering av sensorn, kan det bli nödvändigt att byta ställe oftare på en del patienter. Om hudstatusen förändras, flytta sensor till ett annat ställe.

5. Intravaskulär färgning eller externt pålagd färg såsom nagellack, färg eller färgad kräm kan leda till felaktiga mätningar.
6. Prestandan hos DS-100A försämras av rörelse.
7. Använd inte tejp för att sätta fast sensorn, eller för att tejpa den stängd, venösa pulsslag kan resultera i felaktiga mätningar av mättnad.
8. I likhet med all användning av medicinsk utrustning, bör man vara noga med hur kablar går för att minska risken för att patienten skall fastna eller strypas.
9. Använd inte DS-100A eller andra syresensorer vid MRI-scanning. Ström kan orsaka brännsår. Dessutom kan DS-100A påverka MRI-bilden, och MRI-enheten kan påverka oximetrimätningens noggrannhet.
10. Ändra inte eller modifiera DS-100A. Ändringar eller modifieringar kan påverka prestanda eller noggrannhet.

Om du har frågor angående denna information, kontakta Nellcors avdelning för teknisk service, eller din lokala Nellcor-representant.

Garanti

För att få information om eventuell garanti för denna produkt, kontakta Nellcors avdelning för teknisk service, eller din lokala Nellcor-representant.

Precisionsspecifikationer

För variationsvidden av precisionsspecifikationen vid användning av Nellcor-monitorer, hänvisas till informationen som bifogats produkten, eller man kan även kontakta (i USA) Nellcors avdelning för teknisk service. Utanför USA, kontakta din lokala Nellcor-representant.

För variationsvidden av precisionsspecifikationen vid användning av andra monitorer än de som tillverkats av Nellcor, hänvisas till den information som tillhandahållits av tillverkaren av instrumentet.

OBS! Hänvisa till instrumentets bruksanvisning för fullständiga instruktioner angående användning av sensorn tillsammans med specifik monitor.

Denna sensor skyddas av följande patent i USA och motsvarande internationella patent: 6,708,049; 6,591,123 och 4,685,464.

© 2005 Nellcor Puritan Bennett Inc. Alla rättigheter förbehålls.

OxiMAX® DS-100A Durasensor

Iltsensor til voksne

Brugsanvisning

Indicaciones/Contraindicaciones

Nellcor Durasensor iltsensor til voksne, model DS-100A, er indiceret til brug, når der kræves kontinuerlig, ikke-invasiv overvågning af arteriel iltmætning og pulsslag hos patienter, der vejer mere end 40 kg.

DS-100A er kontraindiceret til brug på aktive patienter eller til længere tids brug. Den er ikke designet til langtidsovervågning. Den skal flyttes hver 4. time (eller hyppigere, hvis cirkulationsstatus og/eller hudens integritet indikerer dette), og sensoren placeres et nyt sted. I tilfælde af, at en langtidsovervågning er påkrævet, bruges en OxiMAX-iltsensor (MAX-A, MAX-AL eller MAX-N) eller en Oxisensor II-sensor (D-25, D-25L eller N-25), afhængig af patientens alder og størrelse samt af instrumentkompatibiliteten. www.DataSheet4U.com

Brugsanvisning

Denne sensor må kun anvendes sammen med Nellcor-instrumenter og instrumenter med Nellcor-oxymetri eller sammen med instrumenter med licens til anvendelse af Nellcor-sensorer (Nellcor-kompatible instrumenter). Denne sensor har indbygget Nellcor OxiMAX® teknologi. Når denne sensor er tilsluttet til et OxiMAX-aktiveret instrument, benytter den OxiMAX-teknologi til yderligere avancerede sensorfunktioner. Oplysning om givne instrument- og sensormodellers funktioner og kompatibilitet fås hos de pågældende producenter.

Genanvendelige sensorer kan bruges på det samme sted i højst 4 timer, forudsat at stedet undersøges rutinemæssigt for at sikre hudens integritet og sensorens korrekte placering. Da den enkelte patients hudtilstand påvirker hudens evne til at tolerere sensoren, kan det være nødvendigt at skifte sensorsted hyppigere hos nogle patienter end hos andre.

Sådan anvendes DS-100A:

1. Sæt en pegefinger over sensorvinduet på DS-100A med fingerspidsen mod fingerstoppet. **(1)**
2. Hvis fingerneflen er lang, rager neglespidsen ud over fingerstoppet. **(2)**

3. Bred sensorens bageste faner ud for at fordele styrken over hele pudernes længde. Kontrollér sensorens placering. Hvis en pegefinger ikke kan placeres rigtigt, eller hvis der ikke er en pegefinger til rådighed, kan en mindre finger bruges. Alternativt kan en OxIMax eller en Oxisensor II-itsensor anvendes. Benyt ikke DS-100A på en tommelfinger eller en tå eller hen over hånden eller foden på et barn. **(3)**

Bemærk: Når sensorstedet vælges, bør man prioritere en ekstremitet, der ikke er forsynet med et arterielt kateter, en blodtryksmanchet eller en intravaskulær infusionslange.

4. Sensoren skal vende på en sådan måde, at kablet ligger langs med håndryggen. **(4)**
5. Stik DS-100A i oximeteret, og kontrollér, at sensoren virker korrekt som beskrevet i oximeterets brugsanvisning.

Bemærk: Hvis sensoren ikke sporer pulsen pålideligt, er den måske forkert placeret, eller sensorstedet kan være for tykt, for tyndt, for dybt pigmenteret eller på anden måde farvet i dybden (det kan være som resultat af en eksternt påført farvning som for eksempel neglelak, farve eller pigmenteret creme), så en passende lystransmission ikke er mulig. Hvis en sådan situation forekommer, skal sensoren eller en anden Nellcor-sensor placeres et andet sted.

Rengøring

DS-100A kan overfladerengøres ved at tørre den af med en opløsning som f.eks. 70% isopropylalkohol. Brug en 1:10 blegemiddelopløsning, hvis der kræves en lav desinfektionsgrad. Benyt ikke ufortyndet blegemiddel (5%~5,25% natriumhypochlorit) eller nogen andre rengøringsopløsninger end de her anbefalede, da dette vil kunne medføre permanent beskadigelse af sensoren.

FORSIGTIG: Stikbenene må ikke udsættes for rengøringsopløsning, da det kan skade sensoren.

Sådan rengøres eller desinficeres sensoren:

1. Væd en ren, tør gazeklud med rengøringsmidlet. Aftør alle sensorens og kablets overflader med kluden.
2. Væd en anden ren, tør gazeklud med sterilt eller destilleret vand. Aftør alle sensorens og kablets overflader med kluden.
3. Tør sensoren og kablet ved at tørre alle overfladerne af med en ren, tør gazeklud.

FORSIGTIG

1. Må ikke steriliseres med stråling, damp eller ethylenoxid. Sådan sterilisering kan skade sensoren.
2. Hvis DS-100A ikke anvendes korrekt, kan det medføre ukorrekte målinger.
3. Hvis DS-100A anvendes i umiddelbar nærhed af kraftigt lysende lamper, kan det resultere i unøjagtige målinger. I sådanne tilfælde kan sensoren dækkes med et lysuigennemtrængeligt materiale.

4. Genanvendelige sensorer skal flyttes til et nyt sted mindst hver 4. time. Da den enkelte patients hudtilstand påvirker hudens evne til at tolerere sensoren, kan det være nødvendigt at skifte sensorsted hyppigere hos nogle patienter end hos andre. Hvis hudens integritet ændrer sig, skal sensoren flyttes til et andet sted.
 5. Intravaskulære farver eller eksternt påført farvning som f.eks. neglelak, farve eller pigmenteret creme kan føre til unøjagtige målinger.
 6. DS-100A-sensorers ydelse kompromitteres af bevægelse.
 7. Benyt ikke tape til at holde sensoren på plads eller til at lukke den. Venøse pulseringer kan medføre unøjagtige mætningsmålinger.
 8. Som med alt medicinsk udstyr skal man føre kablerne omhyggeligt for at reducere risikoen for, at patienten vikles ind i dem eller bliver kvalt.
 9. Benyt ikke DS-100A eller andre oximetri-sensorer under MRI-scanning. Ledet strøm kan forårsage forbrændinger. Desuden kan DS-100A påvirke MRI-billedet, og MRI-enheden kan påvirke nøjagtigheden af oximetri-målingerne.
 10. Foretag ikke ændringer af DS-100A. Ændringer kan påvirke ydeevnen eller nøjagtigheden.
- Hvis du har spørgsmål vedrørende nogle af disse oplysninger, bedes du kontakte Nellcors Technical Services Department eller den lokale Nellcor-repræsentant.

Garanti

Oplysninger om en garanti, hvis der er en sådan på dette produkt, fås i Nellcors Technical Services Department eller hos den lokale Nellcor-repræsentant.

Nøjagtighedsspecifikationer

Hvis du ønsker oplysninger om nøjagtighedsspecifikationerne ved brug sammen med Nellcor-monitorer, bedes du se den information, der blev leveret sammen med monitoren, eller (i USA) kontakte Nellcors Technical Services Department. Uden for USA bedes du kontakte den lokale Nellcor-repræsentant.

Hvis du ønsker oplysninger om nøjagtighedsspecifikationerne ved brug sammen med en monitor, der er fremstillet af en anden producent end Nellcor, bedes du se den information, der blev leveret sammen med det pågældende instrument.

Bemærk: Se brugsanvisningen til instrumentet for at få fuld instruktion i brugen af sensoren sammen med den pågældende monitor.

Denne sensor sælges under følgende amerikanske patenter og tilsvarende udenlandske patenter: 6,708,049, 6,591,123 og 4,685,464.

© 2005 Nellcor Puritan Bennett Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

OXIMAX® DS-100A Durasensor

Oksygensensor for voksne

Bruksanvisning

Indikasjoner/kontraindikasjoner

Nellcor Durasensor-oksygensensor for voksne, modell DS-100 A, indikeres for bruk når kontinuerlig non-invasiv overvåking av arteriell oksygenmetning og pulsfrekvens er nødvendig for pasienter over 40 kg.

DS-100A kontraindikeres for bruk på aktive pasienter eller for lengre tids bruk. Den er ikke konstruert for overvåking i lengre tid. Den må flyttes hver 4. time (eller oftere hvis kretsløpets status og/eller hudens integritet tilsier det) og settes på et annet sted. Hvis overvåking på lang sikt kreves, skal en OxiMAX-oksygensensor (MAX-A, MAX-AL eller MAX-N) eller en Oxisensor II®-sensor (D-25, D-25L eller N-25) brukes, avhengig av pasientens alder eller størrelse, samt instrumntkompatibilitet.

Bruksanvisning

Sensoren skal bare brukes sammen med Nellcor-instrumenter og instrumenter som inneholder Nellcor-oksymetri, eller med instrumenter som er lisensiert til å bruke Nellcor-sensorer (Nellcor-kompatible instrumenter). Denne sensoren integrerer Nellcor OxiMAX®-teknologi i sin konstruksjon. Når den kobles til et OxiMAX-kompatibelt instrument, bruker sensoren OxiMAX-teknologi til å utføre avanserte tilleggsfunksjoner. Kontakt de enkelte produsentene for opplysninger om funksjoner og kompatibilitet for bestemte instrumenter og sensormodeller.

Gjenbrukbare sensorer kan brukes på samme sted i maksimalt 4 timer, forutsatt at dette kontrolleres regelmessig for å passe på hudens tilstand og riktig plassering av sensor. Siden hudens tilstand påvirker hudens evne til å tolerere sensoren, kan det være nødvendig å bytte sensorsted oftere på enkelte pasienter.

Slik setter du DS-100A på:

1. Plasser en pekefinger over sensorvinduet på DS-100A med fingertuppen mot stoppet. **(1)**
2. Hvis fingerneeglen er lang, går negletuppen over fingerstoppet. **(2)**

3. Åpne de bakre tappene på sensoren for å fordele trykket jevnt over hele putens lengde. Kontroller sensorens posisjon. Hvis en pekefinger ikke kan plasseres riktig eller ikke er tilgjengelig, kan du bruke en kortere finger eller bruke en OxiMAX- eller Oxisensor II-oksygensensor. DS-100A får ikke brukes på en tommel eller tå eller på tvers av et barns hånd eller fot. **(3)**

Merk! Ved valg av sensorsted bør det helst velges en ekstremitet uten arteriekateter, blodtrykksmansjett eller intravaskulær infusjonslinje.

4. Sensoren skal rettes inn på en slik måte at kabelen plasseres langs toppen av hånden. **(4)**
5. Sett DS-100A inn i oksymeteret, og kontroller korrekt funksjon som beskrevet i oksymeterets brukerhåndbok.

Merk! Unøyaktig pulsavlesning kan skyldes feilplassering av sensoren — eller at sensorstedet er for tykt, tynt eller pigmentert, eller på annen måte farget (for eksempel med ytre fargemidler som neglelakk, hårfarge eller brunkrem), slik at lysoverføringen forstyrres. I slike tilfeller skal sensoren flyttes eller en annen Nellcor-sensor brukes på et annet sted.

Rengjøring

Overflaten på DS-100A kan rengjøres ved å tørke av den med en løsning som 70 %-isopropylalkohol. Hvis lavere grads desinfisering kreves, skal du bruke en blekemiddelløsning med blandingsforhold 1:10. Du skal ikke bruke ufortynnet blekemiddel (5–5,25 % natriumhypokloritt) eller noe annet rengjøringsmiddel enn de som er anbefalt her, dette på grunn av faren for varig skade på sensoren.

FORSIKTIG! Du skal ikke eksponere kontaktpinner for rengjøringsløsning, siden dette kan skade sensoren.

Slik rengjør eller desinfiserer du sensoren:

1. Gjennombløt en ren og tørr gasbindpute med rengjøringsløsning. Tørk av alle overflater på sensoren og kabelen med denne gasbindputen.
2. Gjennombløt nok en ren og tørr gasbindpute med sterilt eller destillert vann. Tørk av alle overflater på sensoren og kabelen med denne gasbindputen.
3. Tørk sensoren og kabelen ved å tørke av alle overflater med en ren og tørr gasbindpute.

FORSIKTIGHETSREGLER

1. Sterilisering skal ikke foretas ved hjelp av stråling, damp eller etylenoksid. Slik sterilisering kan skade sensoren.
2. Hvis DS-100A ikke settes riktig på, kan det føre til målefeil.
3. Bruk av DS-100A i nærvær av sterkt lys kan gi unøyaktige målingsresultater. I slike tilfeller skal sensoren dekkes til med et ugjennomsiktig materiale.
4. Gjenbrukbare sensorer må flyttes til et nytt sted minst hver 4. time. Siden hudens tilstand påvirker dens evne til å tolerere sensoren, kan det være nødvendig å bytte sensorsted oftere på enkelte pasienter. Ved hudirritasjon bør sensoren flyttes.

www.DataSheet4U.com

5. Intravaskulære fargemidler eller ytre påført farge som neglelakk, hårfarge eller brunkrem kan forårsake feilmålinger.
6. Ytelsen til DS-100A reduseres ved bevegelse.
7. Det skal ikke settes på teip for å holde sensoren på plass eller for å lukke den. Venøse pulssasjoner kan føre til unøyaktige metningsmålinger.
8. Som med annet medisinsk utstyr skal pasientkabler plasseres slik at risikoen for pasientinnvikling og -kvelning minimeres.
9. DS-100A eller andre oksymetrisensorer skal ikke brukes under MRI-skanning. Ledet strøm kan gi forbrenninger. DS-100A kan også påvirke MRI-bildet, og MRI-enheten kan påvirke nøyaktigheten til oksymetrimålingene.
10. Du skal ikke foreta endringer på DS-100A. Endringer eller modifikasjoner kan påvirke ytelsen og nøyaktigheten.

Hvis du har spørsmål angående dette dokumentet, kan du kontakte Nellcors tekniske serviceavdeling eller din lokale Nellcor-representant.

Garanti

Du kan få informasjon om eventuelle produktgarantier ved å kontakte Nellcors avdeling for teknisk støtte eller den lokale Nellcor-representanten.

Nøyaktighetsspesifikasjoner

Når det gjelder nøyaktighetsspesifikasjoner ved bruk med Nellcor monitorer, se informasjonen som følger med monitoren, eller kontakt Nellcors Technical Services Department (i USA). Utenfor USA kan du også kontakte den lokale Nellcor-representanten.

Nøyaktighetsspesifikasjonsområder ved bruk sammen med andre målere enn Nellcor-produserte målere kan du finne informasjon om i dokumentasjonen som fulgte med fra produsenten av instrumentet.

Merk! Se instrumentets brukerhåndbok angående fullstendige instruksjoner om bruk av sensoren sammen med den måleren.

Denne sensoren selges under følgende amerikanske og utenlandske patenter: 6,708,049; 6,591,123 og 4,685,464.

© 2005 Nellcor Puritan Bennett Inc. Med enerett.

OXIMAX® DS-100A Durasensor

Aikuisten happisaturaatioanturi

Rx ONLY

Käyttöohjeet

Indikaatiot/kontraindikaatiot

Aikuisten Nellcor Durasensor -happisaturaatio anturi malli DS-100A on tarkoitettu käytettäväksi yli 40 kg painavien potilaiden non-invasiiviseen happisaturaation ja syketaajuuden tarkkailuun.

DS-100A-anturi on kontraindikoitu aktiivisilla potilailla ja pitkäaikaisessa käytössä. Sitä ei ole tarkoitettu pitkäaikaiseen tarkkailuun. Anturin paikkaa on vaihdettava 4 tunnin välein (tai useammin, jos verenkierto ja/tai ihon kunto niin vaatii). Pitkäaikaiseen tarkkailuun käytetään OxiMAX-happisaturaatioanturia (MAX-A, MAX-AL tai MAX-N) tai Oxisensor II® -anturia (D-25, D-25L tai N-25) potilaan iän, koon ja monitorin yhteensopivuuden mukaisesti.

www.DataSheet4U.com

Käyttöohjeet

Tätä anturia saa käyttää ainoastaan Nellcorin monitorien ja Nellcorin oksimetritekniikan sisältävien monitorien kanssa tai sellaisten monitorien kanssa, joilla on Nellcorin antureiden käyttölisenssi (Nellcor-yhteensopivat monitorit). Tässä anturissa käytetään Nellcor OxiMAX® -teknologiaa. Kun anturi liitetään OxiMAX in kanssa yhteensopivaan monitoriin, anturin käyttämä OxiMAX-teknologia mahdollistaa lisäominaisuuksien hyödyntämisen. Lisätietoja monitorien ja anturimallien ominaisuuksista ja yhteensopivuudesta saa laitteen valmistajalta.

Monikäyttöisiä antureita voidaan käyttää samassa kiinnityskohdassa enintään 4 tuntia edellyttäen, että ihon tila ja anturin sijainti kiinnityskohdassa tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Koska ihon kunto vaikuttaa siihen, miten anturia siedetään, joillakin potilailla anturin paikkaa voidaan joutua muuttamaan useammin.

DS-100A-anturin kiinnittäminen:

1. Aseta etusormi DS-100A-anturin ikkunan päälle niin, että sormenpää koskettaa anturin pysäytintä. **(1)**
2. Jos kynsi on liian pitkä, se koskettaa pysäytintä ennen sormenpäättä. **(2)**
3. Levitä anturin takakielekkeet, jotta paino jakaantuu tasaisesti tyynyjen koko mitalta. Tarkista anturin sijaintikohta. Jos etusormeaa ei voida sijoittaa oikein paikalleen tai se ei ole

www.DataSheet4U.com

käytettävissä, voidaan käyttää pienempää sormea, tai anturiksi voidaan vaihtaa OxIMax tai Oxisensor II. DS-100A-anturia ei saa käyttää peukalossa, varpaassa, lapsen kädessä tai jalassa. **(3)**

Huomautus: Anturikohtaa valittaessa on käytettävä raajaa, jossa ei ole valtimokatetria, verenpainemansettia tai suonensisäistä infuusioletkua, mikäli mahdollista.

4. Anturi on kohdistettava niin, että johto lepää käden päällä sen suuntaisesti. **(4)**
5. Kiinnitä DS-100A-anturi oksimetriin ja varmista sen asianmukainen toiminta oksimetrin käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.

Huomautus: Jos anturi ei mittaa sykettä oikein, se voi olla asetettu väärin paikoilleen tai mittauskohta voi olla liian paksu, ohut tai liian pigmenttinen tai muuten värjäytynyt (esim. ulkoisen värjäävän aineen johdosta kuten kynsilakka, väriaine tai värillinen voide), jolloin valo ei läpäise ihoa riittävästi. Näissä tilanteissa anturi on sijoitettava toiseen paikkaan tai on käytettävä toista Nellcorin anturia eri kohdassa.

Puhdistaminen

DS-100A-anturin pinta voidaan puhdistaa pyyhkimällä se esim. 70 % isopropyylialkoholilla. Jos se on desinfioitava, käytä valkaisuainetta 1:10 suhteessa. Älä käytä laimentamatonta valkaisuainetta (5 %~5,25 % natriumhypokloriittia) tai muita kuin tässä suositeltuja puhdistusliuoksia, sillä ne voivat aiheuttaa pysyviä anturin vaurioita.

VAROTOIMI: Älä altista liittinastoja puhdistusliuokselle, sillä se voi vaurioittaa anturia.

Anturin puhdistaminen tai desinfiointi:

1. Kastele puhdas ja kuiva sideharsotaitos puhdistusliuoksella. Pyyhi anturin ja johdon pinnat kostealla sideharsotaitoksella.
2. Kastele toinen puhdas, kuiva sideharsotaitos steriilillä tai tislattulla vedellä. Pyyhi anturin ja johdon pinnat kostealla sideharsotaitoksella.
3. Kuivaa anturi ja johto pyyhkimällä pinnat puhtaalla ja kuivalla sideharsotaitoksella.

VAROTOIMET

1. Ei saa steriloida sädetämällä, höyryllä tai etyleenioksidilla. Nämä sterilointimenetelmät voivat vaurioittaa anturia.
2. Jos DS-100A-anturia ei kiinnitetä kunnolla, mittaustulokset voivat olla virheellisiä.
3. DS-100A-anturin käyttö kirkkaassa valossa voi johtaa virheellisiin mittaustuloksiin. Näissä olosuhteissa anturialue on peitettävä läpinäkymättömällä materiaalilla.
4. Kestokäyttöiset anturit on siirrettävä uuteen kohtaan 4 tunnin välein. Koska ihon kunto vaikuttaa siihen, miten anturia siedetään, joillakin potilailla anturin paikkaa voidaan joutua muuttamaan useammin. Jos ihon kunto heikkenee, siirrä anturi uuteen paikkaan.
5. Suonensisäiset väriaineet tai ulkoisesti käytetyt väriaineet kuten kynsilakka, väriaine tai värillinen voide voivat johtaa virheellisiin mittaustuloksiin.

www.DataSheet4U.com

6. Liike haittaa DS-100A-anturin toimintaa.
7. Älä teippaa anturia paikalleen tai kiinni. Laskimosykkeet voivat aiheuttaa virheellisiä mittaustuloksia.
8. Kaikkia lääketieteellisiä laitteita käytettäessä potilasohdot on reititettävä huolellisesti niin, että potilas ei sotkeudu tai kuristu niihin.
9. DS-100A-anturia tai muita oksimetriantureita ei saa käyttää MRI-kuvantamisen aikana. Johtunut virta voi aiheuttaa palovammoja. DS-100A-anturi voi myös vääristää MRI-kuvaa, ja MRI-yksikkö voi vaikuttaa oksimetriamittausten tarkkuuteen.
10. DS-100A-anturia ei saa muuttaa eikä muuntaa. Muuntelut voivat vaikuttaa toimintaan tai tarkkuuteen.

Lisätietoja saa Nellcorin teknisestä tuesta tai Nellcorin edustajalta.

Takuu

Jos tällä tuotteella on takuu, saat takuusta tietoja ottamalla yhteyttä Nellcorin tekniseen tukeen tai paikalliseen Nellcorin edustajaan.

Tarkkuustiedot

Anturin tarkkuustiedoista, käytettäessä yhdessä Nellcorin monitorien kanssa, on lisätietoja monitorin mukana toimitetuissa ohjeissa. Yhdysvalloissa lisätietoja saa myös Nellcorin teknisestä tuesta. Yhdysvaltojen ulkopuolella on otettava yhteys Nellcorin edustajaan.

Anturin tarkkuustiedot muiden kuin Nellcorin valmistamien monitorien kanssa käytettäessä saa käytössä olevan instrumentin valmistajalta.

Huomautus: Instrumentin käyttöoppaassa on yksityiskohtaiset anturin ja monitorin käyttöä koskevat ohjeet.

Tämä anturi myydään seuraavien Yhdysvaltojen ja vastaavien kansainvälisten patenttien suojaamana: 6,708,049; 6,591,123 ja 4,685,464.

© 2005 Nellcor Puritan Bennett Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

OxiMAX®
DS-100A Durasensor

Transdutor Adulto de Oxigênio

Instrução de Uso

Indicações/Contra-indicações

O transdutor de oxigênio para adultos, Durasensor da Nellcor modelo DS-100A, é indicado para uso quando houver necessidade de monitoramento de saturação de oxigênio arterial contínua não invasiva e taxa de pulso para pacientes com peso maior que 40 kg.

O DS-100A é contra-indicado para uso em pacientes ativos ou para uso prolongado. Esse transdutor não é projetado para monitoramento de longo termo e deve ser removido a cada 4 horas (ou mais frequentemente conforme o status circulatório e/ou a integridade da pele) e reaplicado num local diferente. Se for necessário um monitoramento prolongado, use o sensor de oxigênio OxiMAX (MAX-A, MAX-AL ou MAX-N) ou um sensor Oxisensor II (D-25, D-25L ou N-25), dependendo da idade e tamanho do paciente e da compatibilidade do instrumento.

Instruções de Uso

Este sensor é destinado para uso somente com instrumentos Nellcor, instrumentos contendo oximetria Nellcor ou instrumentos licenciados para usar sensores da Nellcor (instrumentos compatíveis com os da Nellcor). Este sensor tem a tecnologia Nellcor OxiMAX® integrada em seu projeto. Quando conectado a um instrumento compatível com OxiMAX, este sensor utiliza tecnologia OxiMAX para proporcionar recursos avançados adicionais de desempenho do sensor. Consulte os fabricantes específicos para obter informações sobre as características e a compatibilidade dos respectivos modelos de instrumentos e sensores.

Os sensores reutilizáveis podem ser usados no mesmo local por um máximo de 4 horas, desde que o local seja inspecionado regularmente para assegurar a integridade da pele e a posição adequada. As condições específicas de cada pele afetam a capacidade de tolerar o sensor, portanto, pode ser necessário mudar o sensor de local mais frequentemente em alguns pacientes.

Para aplicar o DS-100A:

1. Coloque o dedo indicador sobre a janela do sensor do DS-100A acomodando a ponta na extremidade interna do sensor. **(1)**

2. Se a unha for muito longa ela deverá passar além do ponto onde a ponta do dedo deve ser acomodada. **(2)**
3. Separe as abas do sensor para fazer com que a pressão seja aplicada por igual ao longo dos protetores internos do sensor. Verifique a posição do sensor. Se o indicador não puder ser posicionado corretamente, aplique-o num dedo menor ou utilize um sensor OxiMAX ou Oxisensor II. Não use o modelo DS-100A no polegar, nos dedos do pé ou nas mãos ou nos pés de crianças. **(3)**

Observação: Ao selecionar um local para o sensor, escolha uma extremidade livre de dispositivos como cateter arterial, medidor de pressão arterial ou linhas de infusão intravascular.

4. O sensor deve ser orientado de forma que o cabo esteja posicionado ao longo da parte posterior da mão. **(4)**
5. Conecte o DS-100A no oxímetro e verifique se está operando de maneira adequada conforme descrito no manual do operador do oxímetro.

Observação: Se o sensor não estiver monitorando o pulso de forma confiável, é possível que esteja posicionado incorretamente ou o local do sensor pode ser muito espesso, muito fino ou de pigmentação muito profunda, ou fortemente colorido de outra forma (como aplicação externa de esmalte de unha, corante ou creme pigmentado) para permitir a transmissão da luz. Se esse for o caso, reposicione o sensor ou escolha um modelo alternativo de sensor da Nellcor para utilização num local diferente.

www.DataSheet4U.com

Limpeza

O sensor DS-100A pode ser limpo pelo método de limpeza de superfície com uma solução de álcool isopropílico a 70%. Se for necessária a esterilização de baixo nível utilize uma solução de cândida de 1 por 10. Não use cândida concentrada (5% a 5,25% de hipoclorito de sódio) ou outra solução além daquela recomendada pois isso pode causar danos permanentes ao sensor.

CUIDADO: Não aplique solução de limpeza nos pinos do conector, pois tal pode danificar o sensor.

Para limpar ou desinfetar o sensor faça o seguinte:

1. Sature uma gaze seca e limpa com a solução de limpeza. Passe a gaze saturada sobre as superfícies do sensor e do cabo.
2. Sature outra gaze seca e limpa com água esterilizada ou destilada. Passe a gaze sobre todas as superfícies do sensor e do cabo.
3. Enxugue o sensor e cabo com uma gaze seca e limpa.

CUIDADO

1. Não faça a esterilização por irradiação, vapor ou óxido de etileno, pois tal pode danificar o sensor.
2. Se o DS-100A não for aplicado de maneira adequada ele pode apresentar dados incorretos.

www.DataSheet4U.com

3. O uso do DS-100A em presença de luz muito brilhante pode produzir um monitoramento impreciso. Nesse caso, cubra o sensor com um material opaco.
4. Os sensores reutilizáveis devem ser mudados para um novo local pelo menos a cada quatro horas. As condições específicas de cada pele afetam a capacidade de tolerar o sensor, portanto pode ser necessário mudar o sensor de local com mais frequência em alguns pacientes. Se a integridade da pele mudar, remova o sensor para outro local.
5. Os líquidos de contraste intravasculares ou coloração externamente aplicada como, por exemplo, esmalte de unha, corante ou creme pigmentado, podem provocar uma medição incorreta.
6. O desempenho do DS-100A pode ser prejudicado pelo movimento.
7. Não aplique fitas adesivas para fixar o sensor no local ou para cobri-lo; as pulsações venosas podem interferir na medição da saturação.
8. Roteie os cabos cuidadosamente para reduzir a possibilidade do paciente se enroscar ou o perigo de estrangulamento.
9. Não use o DS-100A ou outros sensores de oximetria durante o processo de ressonância magnética. A corrente conduzida pode causar queimaduras. Além disso, o DS-100A pode afetar a imagem da ressonância magnética e a unidade de ressonância magnética pode interferir na precisão dos dados da oximetria.
10. Não altere ou modifique o DS-100A. Alterações ou modificações podem afetar a performance e ou precisão do sensor.

Se houver perguntas referentes a estas informações, contate o Departamento de Serviços Técnicos da Nellcor ou o seu representante local.

Garantia

Para obter informações relativas à garantia deste produto, se houver, entre em contato com os Serviços Técnicos da Nellcor ou com o representante local da Nellcor.

Especificações de Precisão

Para consultar a escala de especificações de precisão ao usar o sensor com monitores Nellcor, veja as informações fornecidas com o monitor ou (nos E.U.A.) contate o Departamento de Serviços Técnicos da Nellcor (Nellcor's Technical Services Department). Em outros países, contate o representante local da Nellcor.

Para consultar a escala de especificações de precisão ao usar o sensor com monitores fabricados por terceiros, veja as informações fornecidas pelo fabricante.

Observação: Veja o manual do operador do instrumento para as instruções completas de uso do sensor com o monitor específico.

Este sensor é vendido sob as seguintes patentes americanas e de outros países: 6.708.049, 6.591.123 e 4.685.464.

OxiMax® DS-100A Durasensor

Кислородный датчик для взрослых

Указания по использованию

Показания и противопоказания

Кислородный датчик для взрослых Nellcor Durasensor модели DS-100A рекомендуется применять тогда, когда требуется постоянный неинвазивный контроль насыщения артериальной крови кислородом и частоты пульса у пациентов весом более 40 кг.

Датчик DS-100A не следует применять для контроля состояния активных пациентов или при необходимости длительного использования. Он не предназначен для долговременного контроля. Данный датчик необходимо перемещать и устанавливать на новое место каждые 4 часа (или более часто, если этого требуют показатели кровообращения или целостности кожи пациента). Если требуется долговременный контроль, используйте кислородный датчик OxiMax (MAX-A, MAX-AL или MAX-N) или датчик Oxisensor II (D-25, D-25L или N-25), в зависимости от возраста и веса пациента и совместимости прибора.

Указания по использованию

Используйте этот датчик только с инструментами Nellcor и инструментами с оксиметрией Nellcor, или с инструментами, имеющими лицензию на использование датчиков Nellcor (инструментами, совместимыми с Nellcor). В данном датчике использована технология Nellcor OxiMax®. При подключении к инструменту с использованием OxiMax этот датчик применяет технологию OxiMax для обеспечения дополнительных функций датчика. Для получения информации о совместимости датчика с используемым оборудованием, а также о технических характеристиках данного оборудования обращайтесь к производителю.

Датчики многоцветового использования можно держать на одном месте не более 4 часов при условии регулярного контроля целостности кожи и правильности положения датчика. Поскольку состояние кожи влияет на ее способность выдерживать воздействие датчика, для некоторых пациентов может быть необходимо перемещать датчик на другое место более часто.

Установка датчика DS-100A:

1. Поместить указательный палец на окошко датчика DS-100A, уперев кончик пальца в упор. **(1)**

2. Если на пальце длинный ноготь, то конец ногтя будет при этом находиться над упором. **(2)**
3. Развести задние лапки датчика, чтобы обеспечить равномерное усилие по длине подкладок. Проверить положение датчика. Если нет возможности правильно расположить указательный палец или указательный палец нельзя использовать, можно использовать меньший палец или же кислородные датчики OxiMax или Oxisensor II. Не следует устанавливать датчик DS-100A на большой палец, палец ноги или же поперек кисти или ступни ребенка. **(3)**

Примечание: При выборе места установки датчика предпочтение следует отдавать конечности, на которой не установлены артериальный катетер, манжета для измерения кровяного давления или трубка для внутривенного вливания.

4. Датчик должен быть ориентирован таким образом, чтобы его кабель находился сверху кисти пациента. **(4)**
5. Вставить разъем датчика DS-100A в разъем оксигемометра и убедиться в его правильном функционировании, как описано в руководстве оператора прибора.

Примечание: Если датчик не дает надежных показаний частоты пульса, причина может быть в том, что он неправильно расположен, или же кожа в месте расположения датчика слишком толстая, слишком тонкая, сильно пигментированная или по иной причине имеет слишком интенсивную окраску (например от лака для ногтей, наружного красителя или пигментированного крема), что препятствует должному прохождению света. При наличии любой из этих ситуаций датчик необходимо переместить на другое место или применить другой датчик Nellcor, установив его на другое место.

Очистка датчика

Поверхность датчика DS-100A можно очищать путем его протирки раствором типа 70%-ного изопропилового спирта. Если требуется легкая дезинфекция, применяйте раствор отбеливателя концентрацией 1:10. Во избежание постоянного повреждения датчика не следует использовать неразбавленный отбеливатель (5~5,25%-ный гипохлорит натрия) или какие-либо другие чистящие растворы, кроме рекомендуемых в настоящем руководстве.

ВНИМАНИЕ: Не допускайте контакта штырьков разъемов с очищающим раствором, поскольку это может привести к повреждению датчика.

Очистка и дезинфекция датчика:

1. Смочить чистый сухой марлевый тампон чистящим раствором. Протереть этим тампоном все поверхности датчика и кабеля.
2. Смочить другой чистый сухой марлевый тампон стерилизованной или дистиллированной водой. Протереть этим тампоном все поверхности датчика и кабеля.
3. Вытереть насухо все поверхности датчика и кабеля чистым сухим марлевым тампоном.

ВНИМАНИЕ!

1. Запрещается стерилизация облучением, паром или этиленоксидом. Подобная стерилизация может привести к повреждению датчика. www.DataSheet4U.com

2. Неправильная установка датчика DS-100A может привести к получению неправильных показаний.
3. Использование датчика DS-100A на ярком свете может привести к получению неточных показаний. При наличии яркого света место установки датчика следует накрывать непрозрачным материалом.
4. Датчики многоразового использования необходимо перемещать на другое место не реже, чем каждые 4 часа. Поскольку состояние кожи влияет на ее способность выдерживать воздействие датчика, для некоторых пациентов может быть необходимо перемещать датчик на другое место более часто. При изменения состояния целостности кожи датчик необходимо переместить на другое место.
5. Применение внутрисосудистых красителей или наружных красящих веществ, таких как лак для ногтей, краситель или пигментированный крем, может привести к получению неточных показаний.
6. Перемещение устройства снижает производительность DS-100A.
7. Не применяйте липкую ленту для фиксирования датчика на месте или его фиксирования в закрытом положении, так как пульсация вен может привести к неточным показаниям насыщения.
8. Так же как и при использовании любого медицинского оборудования, необходимо следить за аккуратной прокладкой кабелей во избежание запутывания или удушения пациента.
9. Не применяйте датчик DS-100A или другие оксигеметрические датчики во время магнито-резонансного сканирования (MRI). Проходящий при этом ток может вызвать ожоги. Кроме того, применение датчика DS-100A может повлиять на изображение MRI, а установка MRI может повлиять на точность показаний оксигеметрии.
10. Не вносите в датчик DS-100A никаких изменений или модификаций. Изменения и модификации могут повлиять на функционирование и точность датчика.

Если у вас есть вопросы в связи с любой приведенной здесь информацией, просим обращаться в службу технической поддержки изделий Nellcor или к вашему местному представителю по изделиям Nellcor.

Гарантия

Информацию о гарантии на данное изделие, если таковая предоставляется, можно получить в службе технической поддержки изделий Nellcor или у вашего местного представителя по изделиям Nellcor.

Показатели точности

Информацию о точности показаний при использовании датчика с регистрирующим устройством Nellcor можно найти в документации, предоставляемой с регистрирующим устройством, или запросить в службе технической поддержки изделий Nellcor (в США). За пределами США просим обращаться к местному представителю по изделиям Nellcor.

www.DataSheet4U.com

Информацию о точности показаний при использовании датчика с регистрирующим устройством, не изготовленным компанией Nellcor, следует искать в документации, предоставленной изготовителем устройства.

Примечание: Полная инструкция по использованию датчика с таким регистрирующим устройством должна быть приведена в руководстве оператора устройства.

Данный датчик продается согласно следующим эквивалентам: 6 708 049; 6 591 123; 4 685 464.

© 2005 Nellcor Puritan Bennett Inc. Все права защищены.

www.DataSheet4U.com

www.DataSheet4U.com

OxiMAX® DS-100A Durasensor

成人血氧传感器

使用指征

适应症 / 禁忌症

Nellcor Durasensor DS-100A 型成人血氧传感器适用于需要非创伤性连续监测动脉血氧饱和度和脉搏、体重超过 40 公斤的患者。

DS-100A 不得用于活动的患者，也不得长时间使用。它不适合长期监控血糖水平。每 4 小时必须移动此传感器（如果血流状态 / 粘贴需要，可在更短的时间内移动传感器），重新粘贴到其它部位。若需要长时间监控，根据患者的年龄和体重以及仪器兼容性，请选用 OxiMAX 血氧传感器（MAX-A、MAX-AL 或 MAX-N）或 Oxisensor II® 传感器（D-25、D-25L 或 N-25）。

使用说明

此传感器只能与 Nellcor 仪器、包含 Nellcor 血氧计的仪器、以及被认可使用 Nellcor 传感器的仪器（Nellcor 兼容仪器）配合使用。本传感器采用了 Nellcor OxiMAX® 技术。在连接 OxiMAX 仪器时，本传感器使用 OxiMAX 技术提供其他先进的传感器功能。如果要了解特定仪器和传感器型号的功能和兼容性，请与各制造商联系。

可重用传感器可在同一部位上最长使用 4 小时，须经常使用此使用部位，纠正传感器的位置和粘贴。由于各人的皮肤情况不一样，可能会影响传感器在皮肤上的附着效果，因此某些患者可能需要经常改变传感器的位置。

粘贴 DS-100A:

1. 将食指放在 DS-100A 传感器窗口上，指尖接触护盾。(1)
2. 若指甲太长，指甲尖可伸过护盾。(2)

3. 展开传感器的背片，在整个垫子长度上施加均匀的力。检查传感器的位置。若不能正确的放下食指，则可使用较小的手指，或者使用 OxIMAX 或 Oxisensor II 血氧传感器。切勿在儿童的拇指或脚趾上使用 DS-100A。 **(3)**

注意：在选择粘贴传感器的部位时，应绝对避开带血压袖带、动脉导管或输血插管的肢体。

4. 放置传感器时，其电缆须沿着手的方向。 **(4)**
5. 将 DS-100A 链接血氧计，并按照操作手册确认血氧计正常工作。

注意：若传感器不能可靠地追踪脉搏，可能是因为它的位置不正确，或者是粘贴传感器的部位太厚、太薄、色素过重或肤色太深（例如擦粉过多或指甲油过厚），使得无法进行正常的光传输。如果发生这些情况，请将传感器换一个部位粘贴，或者选择其他的 Nellcor 传感器。

清洗

可用 70% 异丙醇等溶液擦拭 DS-100A 的表面。若需要低水平的消毒，可使用 1:10 漂白溶液。除推荐的上述溶液外，切勿使用未稀释的漂白溶液（5%~5.25% 次氯酸钠）或任何清洁剂溶液，否则可能会对传感器造成永久损害。

小心：连接器插针不得接触清洁剂溶液，否则会损坏传感器。

传感器的清洁或消毒：

www.DataSheet4U.com

1. 将一块清洁、干燥的海绵垫蘸上清洁剂。用这块海绵垫擦拭传感器的全部表面和电缆。
2. 将另一块清洁、干燥的海绵垫蘸上无菌或蒸馏水。用这块海绵垫擦拭传感器的全部表面和电缆。
3. 用一块清洁、干燥的海绵垫拭干传感器和电缆的所有表面。

小心

1. 切勿使用放射、蒸汽或环氧乙烷等方法进行灭菌。否则会损坏传感器。
2. 若 DS-100A 传感器粘贴不当，可能会使测量不正确。
3. 若在强光下使用 DS-100A，可能会使测量不正确。在这种情况下，请用不透明材料包住传感器部位。
4. 每隔 4 小时，可重用传感器必须移到新的位置。由于各人的皮肤情况不一样，可能会影响传感器在皮肤上的附着效果，因此某些患者可能需要经常改变传感器的位置。若皮肤粘贴有变化，请将传感器移到另一个部位。

www.DataSheet4U.com

5. 血管染色剂或外部着色品，如指甲油或带色护肤品，可能会使测量不正确。
6. 运动会影响 DS-100A 的性能。
7. 不要使用带子来固定传感器，静脉搏动可能会使血氧饱和度读数不准确。
8. 同所有的医疗仪器一样，应小心布线，避免缠绕到患者。
9. 在 MRI 扫描期间，不得使用 DS-100A 传感器或其他血氧计传感器。电流可能引起灼伤。另外，DS-100A 传感器可能会影响 MRI 影像，而 MRI 设备可能会影响血氧测量的准确性。
10. 切勿修改或改装 DS-100A。修改或改变会影响传感器的性能和准确性。

如果您对此有疑问，请与 Nellcor 技术服务部或当地的 Nellcor 代表联系。

担保

要获得有关本产品授权的信息，请致电 Nellcor 技术服务部或当地代表。

准确性规格

有关与 Nellcor 监视器配合使用的准确性规格范围，请参考监视器提供的信息，在美国，您还可与 Nellcor 技术服务部联系。在美国以外，在与当地的 Nellcor 代表联系。

对于与非 Nellcor 制造的监视器配合使用时的准确性规格，请查阅仪器制造商提供的资料。

注意：有关传感器与该类监视器配合使用的完整说明，请查阅仪器操作手册。

本传感器拥有以下美国专利和外国专利：6,708,049、6,591,123 和 4,685,464。

© 2005 Nellcor Puritan Bennett Inc. 保留所有权利。

OXIMAX® DS-100A Durasensor

Czujnik saturacji dla dorosłych pacjentów

Sposób użycia

Wskazania/przeciwwskazania

Czujnik saturacji dla dorosłych pacjentów Nellcor Durasensor, model DS-100A, jest przeznaczony do używania razem z ciągłym nieinwazyjnym monitoringiem saturacji krwi tętnicznej oraz tętna u pacjentów ważących więcej niż 40 kg.

Używanie czujnika DS-100A jest przeciwwskazane u pacjentów aktywnych oraz przy przedłużonym stosowaniu. Czujnik nie jest przeznaczony do monitorowania długotrwałego. Miejsce przyłożenia czujnika należy zmieniać co 4 godziny (lub częściej, jeżeli jest to konieczne ze względu na stan krążenia lub integralność skóry). Jeżeli konieczne jest monitorowanie długoterminowe, należy użyć czujnika saturacji OxiMAX (MAX-A, MAX-AL lub MAX-N) lub czujnika Oxisensor II® (D-25, D-25L lub N-25) w zależności od wieku i rozmiarów pacjenta oraz kompatybilności urządzeń.

Instrukcja stosowania

Czujnik należy używać tylko z aparaturą firmy Nellcor i zawierającą pulsoksymetr firmy Nellcor albo z aparaturą, w której stosowane są czujniki firmy Nellcor (aparaturą zgodną z urządzeniami firmy Nellcor). Konstrukcja czujnika wykonana jest w technologii OxiMAX® firmy Nellcor. Czujnik, po podłączeniu do aparatury obsługującej technologię OxiMAX, zapewni dodatkowe zaawansowane funkcje eksploatacyjne. Informacje na temat funkcji i zgodności poszczególnych aparatów i modeli czujników można uzyskać od ich producentów.

Wielorazowe czujniki można stosować w tym samym miejscu na ciele przez maksymalnie 4 godziny, pod warunkiem przeprowadzania rutynowych badań skóry w tym miejscu oraz kontroli pozycji czujnika. Ponieważ osobniczy stan skóry ma wpływ na zdolność tolerancji założonego czujnika, w przypadku niektórych pacjentów konieczna może być częstsza zmiana miejsca nałożenia czujnika.

W celu nałożenia czujnika DS-100A:

1. Umieścić palec wskazujący nad okienkiem czujnika DS-100A z koniuszkiem palca opierającym się o ogranicznik. **(1)**
2. Jeżeli paznokieć jest długi, końcówka paznokcia będzie wyszła z otworu czujnika. www.DataSheet4U.com

3. Rozewrzeć tylne zakładki czujnika, żeby zapewnić równy nacisk na całą długość podkładki. Sprawdzić pozycję czujnika. Jeżeli nie można prawidłowo ułożyć palca wskazującego lub palec ten nie jest dostępny, można użyć mniejszego palca lub użyć czujnika saturacji OxIMAX albo Oxisensor II. Nie wolno używać czujnika DS-100A na kciuku, palcu u nogi lub dłoni albo stopie dziecka. **(3)**

Uwaga: Przy wybieraniu miejsca założenia czujnika, pierwszeństwo ma kończyzna bez założonego cewnika tętniczego, mankietu pomiaru ciśnienia lub śródnaczyniowego przewodu infuzyjnego.

4. Czujnik należy ustawić w taki sposób, żeby przewód był ułożony wzdłuż grzbietu dłoni. **(4)**
5. Podłączyć czujnik DS-100A do pulsoksymetru i sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo w sposób opisany w instrukcji obsługi pulsoksymetru.

Uwaga: Nieprawidłowe pomiary częstości tętna mogą świadczyć, że czujnik jest źle założony albo miejsce założenia jest zbyt grube, cienkie, ma zbyt głęboką pigmentację lub jest w inny sposób zabarwione (na przykład wskutek nałożenia barwnika lub kremu z pigmentem) i uniemożliwia to prawidłowe przenikanie światła. W takich sytuacjach należy zmienić położenie czujnika lub zastosować inny czujnik firmy Nellcor przeznaczony do użytku w innym miejscu na powierzchni ciała.

Czyszczenie

Czujnik DS-100A może być czyszczony zewnętrznie przez przemywanie go roztworem 70 % alkoholu izopropylowego. Jeżeli wymagana jest dezynfekcja niskiego poziomu, należy użyć roztworu wybielacza i wody zmieszanych w stosunku 1:10. Nie wolno używać nierozcieńczonego wybielacza (5 % ~ 5,25 % podchlorynu sodu) oraz wszelkich środków czyszczących poza tutaj zalecanymi, ponieważ mogą one spowodować trwałe uszkodzenie czujnika.

PRZESTROGA: Nie wolno wystawiać styków złączy na działanie roztworów środków czyszczących, ponieważ takie działanie może spowodować uszkodzenie czujnika.

W celu oczyszczenia lub dezynfekowania czujnika:

1. Nasyć czysty suchy gazik roztworem środka czyszczącego. Przetrzeć tym gazikiem wszystkie powierzchnie czujnika i przewodu.
2. Nasyć kolejny czysty suchy gazik wodą jałową lub destylowaną. Przetrzeć tym gazikiem wszystkie powierzchnie czujnika i przewodu.
3. Osuszyć czujnik i przewód przez przetarcie wszystkich powierzchni suchym gazikiem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Produktu nie wolno wyjaławiać parowo, tlenkiem etylenu lub przez naświetlanie. Takie wyjaławianie może spowodować uszkodzenie czujnika.
2. Nieprawidłowe założenie czujnika DS-100A może skutkować niedokładnością pomiarów.
3. Używanie czujnika DS-100A przy jasnym oświetleniu pomieszczenia może skutkować niedokładnością pomiarów. W takim przypadku należy zakryć czujnik dołączonym matowym materiałem.

www.DataSheet4U.com

4. Czujniki wielorazowe muszą być przenoszone w nowe miejsca przynajmniej raz na 4 godziny. Ponieważ osobniczy stan skóry ma wpływ na zdolność tolerancji założonego czujnika, w przypadku niektórych pacjentów konieczna może być częstsza zmiana miejsca nałożenia czujnika. W razie wystąpienia zmian w stanie skóry, należy przenieść czujnik w nowe miejsce.
5. Barwniki śródnaczyniowe lub zewnętrznie nałożone środki koloryzujące takie, jak lakier do paznokci, barwnik lub krem pigmentujący mogą skutkować niedokładnością pomiarów.
6. Ruch obniża dokładność czujnika DS-100A.
7. Nie wolno przyklejać czujnika taśmą do skóry oraz oklejać go w celu zamknięcia — mogą wystąpić pulsacje żyłne prowadzące do niedokładnych pomiarów saturacji.
8. Tak jak w przypadku wszystkich urządzeń medycznych, należy prawidłowo ułożyć okablowanie, aby zmniejszyć ryzyko zaplątania lub uduszenia.
9. Nie wolno używać czujnika DS-100A ani innych czujników oksymetrycznych podczas skanowania techniką rezonansu magnetycznego (MRI). Wzbudzony prąd może powodować poparzenia. Czujnik DS-100A może również zakłócić obraz MRI, a urządzenie MRI może zakłócić dokładność pomiarów oksymetru.
10. Nie wolno zmieniać ani modyfikować czujnika DS-100A. Zmiany lub modyfikacje mogą zakłócić działanie czujnika lub dokładność pomiarów.

W razie pytań dotyczących niniejszych informacji należy skontaktować się z działem służb technicznych firmy Nellcor lub miejscowym przedstawicielem firmy Nellcor.

www.DataSheet4U.com

Gwarancja

W celu uzyskania informacji na temat ewentualnej rękojmi dla niniejszego produktu, jeżeli dotyczy, należy skontaktować się z wydziałem pomocy technicznej firmy Nellcor lub z jej miejscowym przedstawicielem.

Parametry dokładności pomiaru

Dane dotyczące specyfikacji zakresów dokładności przy użytkowaniu z urządzeniami firmy Nellcor zawierają informacje dostarczone wraz z urządzeniem. W USA można też zasięgnąć ich w dziale służb technicznych firmy Nellcor. Poza USA należy skontaktować się z miejscowym przedstawicielem firmy Nellcor.

W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu dokładności przy stosowaniu z monitorem wyprodukowanym przez firmę inną niż Nellcor, należy zapoznać się z informacjami dostarczonymi przez producenta danego urządzenia.

Uwaga: Pełne instrukcje użycia tego czujnika z danym monitorem zostały zawarte w instrukcji obsługi urządzenia.

Ten czujnik jest sprzedawany zgodnie z jednym z następujących patentów USA lub ich zagranicznych odpowiedników: 6.708.049, 6.591.123 oraz 4.685.464.

OxiMAX® DS-100A Durasensor

Senzor kyslíku pro dospělé pacienty

Návod k použití

Indikace a kontraindikace

Senzor kyslíku pro dospělé pacienty Nellcor Durasensor, model DS-100A, je určen k použití v případě nutnosti trvalého neinvazivního monitorování arteriálního okysličení a tepové frekvence u pacientů s hmotností větší než 40 kg.

Použití senzoru DS-100A je kontraindikováno u aktivních pacientů nebo pro dlouhodobé použití. Senzor není určen k dlouhodobému monitorování. Jednou za 4 hodiny je nutno senzor odstranit a připevnit na jiné místo. Změnu umístění lze provádět i častěji, pokud tato nutnost vyplýve ze stavu krevního oběhu nebo změny integrity kůže. Pokud vyžadujete dlouhodobé monitorování, použijte senzor kyslíku OxiMAX (model MAX-A, MAX-AL nebo MAX-N) nebo senzor Oxisensor II® (model D-25, D-25L nebo N-25), podle věku a velikosti pacienta a podle kompatibility přístroje.

Pokyny k použití

Senzor používejte pouze s přístroji Nellcor a s přístroji založenými na oxymetrii Nellcor, nebo s přístroji, které jsou licencovány pro použití se senzory Nellcor (přístroji kompatibilními s produkty Nellcor). Součástí tohoto senzoru je technologie Nellcor OxiMAX®. Při připojení k přístroji kompatibilnímu s technologií OxiMAX využívá senzor tuto technologii k poskytování dalších rozšířených funkcí senzoru. Informace o funkcích a kompatibilitě jednotlivých přístrojů a modelů senzorů vám poskytnou příslušní výrobci.

Opakovaně použitelné senzory lze použít na stejném místě nejdéle 4 hodiny pod podmínkou, že místo budete pravidelně kontrolovat, abyste se ujistili o neporušenosti kůže a správné poloze senzoru. Jelikož individuální vlastnosti kůže ovlivňují schopnost pokožky snášet umístění senzoru, může být u některých pacientů nutné provádět častější změny umístění senzoru.

Aplikace senzoru DS-100A:

1. Umístěte ukazováček přes okénko senzoru DS-100A (špička prstu musí dosahovat až k zarážce). **(1)**
2. Máte-li dlouhý nehet, položte špičku nehtu přes zarážku. **(2)**

3. Rozevřete zadní úchyty senzoru a snažte se docílit rovnoměrného rozložení tlaku po celé délce plošek. Zkontrolujte polohu senzoru. Pokud ukazováček nelze řádně umístit, nebo pokud jej pacient nemá, lze použít menší prst nebo senzor OxiMAX či Oxisensor II. Nenasazujte senzor DS-100A na palec ruky či chodidla pacienta ani přes ruku či chodidlo dítěte. **(3)**

Poznámka: Při výběru místa aplikace senzoru volte nejprve končetinu bez arteriálního katétru, manžety pro měření krevního tlaku nebo intravaskulární infúzní hadičky.

4. Senzor nasměrujte tak, aby byl kabel položen přes hřbet ruky. **(4)**
5. Zapojte senzor DS-100A do oxymetru a podle pokynů v uživatelské příručce k oxymetru zkontrolujte správnost jeho funkce.

Poznámka: Pokud senzor nesleduje puls spolehlivě, může to být způsobeno tím, že je nesprávně umístěn nebo že je pokožka v místě aplikace senzoru příliš silná, příliš tenká nebo příliš hluboko pigmentována či jinak do hloubky probarvena (například následkem externě aplikovaného probarvení lakem na nehty, barvivem nebo pigmentačním krémem) a nedovoluje řádný průchod světla. Jedná-li se o některou z uvedených situací, přemístěte senzor jinam nebo zvolte jiný senzor Nellcor určený pro použití na jiném místě.

Čištění

Povrch senzoru DS-100A otřete například roztokem 70% izopropylalkoholu. Pokud je zapotřebí provést nízký stupeň dezinfekce, použijte roztok bělidla v poměru 1:10. Nepoužívejte neředěné bělidlo (5%~5,25% chlornan sodný) ani jiné čisticí roztoky, které zde nejsou doporučeny, jelikož by mohlo dojít k trvalému poškození senzoru.

UPOZORNĚNÍ: Kolíky konektoru se nesmí dostat do kontaktu s čisticím roztokem, jelikož by mohlo dojít k poškození senzoru.

Čištění nebo dezinfekce senzoru:

1. Napustěte čistý a suchý vatový tampón čisticím roztokem. Tímto vatovým tampónem otřete všechny plochy senzoru a kabelu.
2. Napustěte další čistý a suchý vatový tampón sterilní nebo destilovanou vodou. Tímto vatovým tampónem otřete všechny plochy senzoru a kabelu ještě jednou.
3. Poté otřete všechny plochy senzoru a kabelu čistým a suchým vatovým tampónem do sucha.

UPOZORNĚNÍ

1. Nesterilizujte zářením, parou ani etylénoxidem. Mohlo by dojít k poškození senzoru.
2. Pokud senzor DS-100A nenasadíte správně, může dojít k nesprávným výsledkům měření.
3. Pokud budete senzor DS-100A používat při jasném osvětlení, může dojít k nepřesným výsledkům měření. V takových případech zakryjte místo aplikace senzoru neprůsvitným materiálem.

4. Opakovaně použitelné senzory přesunujte na nové místo alespoň jednou za 4 hodiny. Jelikož individuální vlastnosti kůže ovlivňují schopnost pokožky snášet umístění senzoru, může být u některých pacientů nutné provádět častější změny umístění senzoru. Pokud se integrita pokožky změní, přesuňte senzor na jiné místo.
5. Intravaskulární barviva nebo externě aplikované probarvení, například lak na nehty, barvivo nebo pigmentační krém, mohou způsobit nepřesné výsledky měření.
6. Při pohybu je ovlivněna účinnost senzoru DS-100A.
7. Nezajišťujte senzor na místě páskou ani senzor páskou nesvírejte; venózní pulsace mohou vést k nepřesným výsledkům okysličení.
8. Stejně jako u jiných zdravotnických přístrojů je i zde důležité vést kabel tak, abyste zabránili možnosti zapletení nebo přiškrtnutí pacienta.
9. Senzor DS-100A ani jiné oxymetrické senzory nepoužívejte v průběhu vyšetřování metodou magnetické rezonance (MRI). Indukovaný proud může způsobit popálení. Senzor DS-100A může také ovlivnit obraz MRI a naopak jednotka MRI může ovlivnit přesnost oxymetrického měření.
10. Neprovádějte u senzoru DS-100A změny ani úpravy. Změny nebo úpravy mohou ovlivnit činnost a přesnost senzoru.

Máte-li dotazy týkající se některé z uvedených informací, obraťte se na technické služby společnosti Nellcor (Nellcor Technical Services Department) nebo na místního zástupce společnosti Nellcor.

www.DataSheet4U.com

Záruka

Informace o záruce na tento produkt, pokud se uplatňuje, získáte na oddělení technických služeb společnosti Nellcor nebo u místního zástupce společnosti Nellcor.

Údaje o přesnosti

Údaje o přesnosti měření při použití senzoru v kombinaci s monitory Nellcor najdete v informacích dodávaných s monitorem nebo se, v rámci USA, obraťte na technické služby společnosti Nellcor.

Mimo USA se obraťte na místního zástupce společnosti Nellcor. Údaje o přesnosti měření při použití senzoru v kombinaci s monitorem, který nevyrobila společnost Nellcor, vám poskytne výrobce tohoto monitoru.

Poznámka: Úplné znění pokynů k použití tohoto senzoru v kombinaci s takovým monitorem naleznete v uživatelské příručce k příslušnému přístroji.

Prodej tohoto senzoru je chráněn následujícími patenty USA a jejich ekvivalenty v zahraničí: 6 708 049, 6 591 123 a 4 685 464.

© 2005 Nellcor Puritan Bennett Inc. Všechna práva vyhrazena.

www.DataSheet4U.com

OXIMAX®
DS-100A Durasensor

Senzor kisika za odrasle

Navodila za uporabo

Indikacije/Kontraindikacije

Senzor kisika za odrasle Nellcor Durasensor, model DS-100A, se uporablja, kadar je potreben neprekinjen neinvazivni nadzor saturacije arterijskega kisika in srčnega utripa pri pacientih, ki tehtajo več kot 40 kg.

DS-100A ne smemo uporabljati pri aktivnih pacientih in za daljše obdobje. Ni namenjen za dolgoročno spremljanje. Vsake štiri ure ga moramo premakniti (ali bolj pogosto, če tako zahteva stanje obtoka in/ali poškodovanost kože) in ga ponovno namestiti na drugo mesto. Če je potrebno dolgoročno spremljanje, uporabite senzor kisika OxiMAX (MAX-A, MAX-AL ali MAX-N) ali senzor Oxisensor II® (D-25, D-25L ali N-25); odvisno od starosti in velikosti pacienta ter kompatibilnosti instrumenta.

Navodila za uporabo

Ta senzor uporabljajte samo z instrumenti Nellcor in instrumenti, ki vsebujejo oksimetrijo Nellcor, ali z instrumenti, ki imajo licenco za uporabo senzorjev Nellcor (instrumenti, kompatibilni z Nellcorjem). Ta senzor ima v svoji izdelavi integrirano tehnologijo Nellcor OxiMAX®. Ko je povezan z instrumentom, ki omogoča OxiMAX, ta senzor uporablja tehnologijo OxiMAX, da priskrbi dodatne napredne funkcije učinkovitosti senzorja. Posvetujte se s posameznim proizvajalcem glede funkcij in kompatibilnosti določenih instrumentov in modelov senzorja.

Senzorje za večkratno uporabo lahko uporabljamo na istem mestu največ štiri ure, če je mesto rutinsko pregledano in smo ugotovili, da je koža nepoškodovana in senzor pravilno nameščen. Ker stanje kože vsakega posameznika različno vpliva na njeno sposobnost, da zdrži namestitev senzorja, bo pri nekaterih pacientih potrebno večkrat zamenjati mesto, na katerem je senzor nameščen.

Za namestitev DS-100A:

1. Položite kazalec na okenca senzorja DS-100A, tako da se konica prsta dotika ovire. **(1)**
2. Če je noht dolg, naj konica nohta sega čez oviro za prst. **(2)**

www.DataSheet4U.com

3. Razširite kraka na zadnji strani senzorja, da ustvarite enakomerno silo po dolžini blazinice. Preverite položaj senzorja. Če kazalca ne morete pravilno namestiti ali ta ni na voljo oz. je prevelik, lahko uporabite manjši prst ali uporabite senzor kisika OxiMAX ali Oxisensor II. Ne uporabljajte DS-100A na palcu ali prstih na nogah ali na otroški roki ali nogi. **(3)**

Opomba: Ko izbirate mesto za namestitev senzorja, morate dati prednost okončini, ki nima arterijskega katetra, namšete za krvni pritisk ali intravaskularne infuzije.

4. Senzor mora biti obrnjen tako, da kabel poteka vzdolž zgornje strani dlani. **(4)**
5. Vključite DS-100A v oksimeter in preverite pravilno delovanje, kot je opisano v priročniku za uporabnike oksimetra.

Opomba: Če senzor ne zaznava utripa zanesljivo, je morda nepravilno nameščen — ali je mesto, na katerem je senzor nameščen, predebelo, pretanko, močno pigmentirano ali drugače pobarvano (npr. lak za nohte, barvilo ali pigmentirana krema) in ne prepušča ustrezne svetlobe. Za rešitev te težave premestite senzor ali izberite alternativni Nellcorjev senzor za uporabo na drugem mestu.

Čiščenje

DS-100A lahko površinsko čistimo z raztopino, kot je 70 odstotni izopropilni alkohol. Če je potrebna manjša stopnja dezinfekcije, uporabite raztopino belila v razmerju 1:10. Ne uporabljajte nerazredčenega belila (5 %–5,25 % natrijev hipoklorid) ali katerikoli drugih čistilnih raztopin, razen priporočenih, saj lahko pride do trajnih poškodb senzorja.

PREVIDNOST: Ne izpostavljajte konektorskih nožič čistilni raztopini, ker lahko poškodujete senzor.

Za čiščenje ali dezinfekcijo senzorja:

1. Prepojite čisto, suho blazinico iz gaze s čistilno raztopino. Obrišite z njo vse površine senzorja in kabel.
2. Prepojite še eno čisto, suho blazinico iz gaze s sterilno ali destilirano vodo. Obrišite z njo vse površine senzorja in kabel.
3. Posušite senzor in kabel tako, da obrišete vse površine s čisto, suho gazo.

PREVIDNOSTI

1. Ne smete sterilizirati z obsevanjem, paro ali etilnim oksidom. Takšna sterilizacija lahko poškoduje senzor.
2. Nepravilna namestitev DS-100A lahko povzroči nepravilne meritve.
3. Uporaba DS-100A pri močni svetlobi lahko povzroči netočne meritve. V takih primerih pokrijte mesto, na katerem je senzor nameščen, z neprozornim blagom.
4. Senzorji za večkratno uporabo se morajo premakniti na novo mesto vsaj vsake štiri ure. Ker stanje kože vsakega posameznika različno vpliva na njeno sposobnost, da zdrži namestitev senzorja, bo pri nekaterih pacientih potrebno večkrat zamenjati mesto, na katerem je senzor nameščen. Če se spremeni stanje kože, premestite senzor na drugo mesto.

www.DataSheet4U.com

5. Intravaskularna barvila ali nanešene barve, kot so lak za nohte, barvilo ali pigmentacijska krema, lahko povzročijo nepravilne meritve.
6. Učinkovitost DS-100A je manjša ob premikanju.
7. Ne uporabljajte traku, da bi obdržali senzor na mestu; venozni utrip lahko povzroči nepravilne meritve saturacije.
8. Kot pri vseh medicinski opremi pazljivo namestite kable, da zmanjšate možnost, da bi se pacient zapletel ali zadavil.
9. Ne uporabljajte senzorja DS-100A ali drugih oksimetričnih senzorjev med MRI-pregledom. Prevodni tok lahko povzroči opekline. Prav tako lahko DS-100A vpliva na MRI-sliko in MRI-enota lahko vpliva na točnost oksimetričnih meritev.
10. Ne spreminjajte ali prilagajajte senzorja DS-100A. Spremembe ali prilagoditve lahko vplivajo na učinkovitost ali točnost.

Z dodatnimi vprašanji glede the inforamcij, se obrnite na Nellcorjev oddelek za tehnične storitve ali na svojega lokalnega Nellcorjevega zastopnika.

Garancija

Za pridobitev podatkov o garanciji, če ta obstaja, se obrnite na Nellcorjev oddelek za tehnične storitve ali na svojega lokalnega Nellcorjevega zastopnika.

Specifikacije točnosti

Za podatke o stopnji točnosti senzorja, ko se ga uporablja z Nellcorjevimi monitorji pogledjte informacije, ki so priložene monitorju, ali (v ZDA) se obrnite na Nellcorjev oddelek za tehnične storitve. Če ne živite v ZDA, se obrnite na svojega lokalnega Nellcorjevega zastopnika.

Za podatke o stopnji točnosti senzorja, ko se ga uporablja z monitorji, ki jih ni izdelal Nellcor, pogledjte informacije, ki jih je priložil proizvajalec.

Opomba: Vsa navodila za uporabo senzorja z monitorjem lahko najdete v priročniku za uporabnike.

Ti senzorji se prodajajo na podlagi podeljenih ameriških patentov in tujih ustreznikov: 6,708,049; 6,591,123 in 4,685,464. 6,708,049; 6,591,123 in 4,685,464.

© 2005 Nellcor Puritan Bennett Inc. Vse pravice pridržane.

**OxiMAX®
DS-100A Durasensor**

Felnőtt oxigénérzékelő

Használati útmutató

Javallatok/Ellenjavallatok

A Nellcor Durasensor felnőtt oxigénérzékelő, DS-100A modellszámú változatának használata akkor javallott, amikor folyamatos noninvaszív artériás oxigénszaturációra és a pulzusszám monitorozásra van szükség 40 kg-nál nagyobb tömegű betegeknél.

A DS-100A használata ellenjavallott aktív betegeknél és tartós használat esetén. Hosszú távú monitorozásra nem alkalmas. 4 óránként (vagy gyakrabban, ha a keringési állapot és/vagy a bőr állapota megkívánja) át kell helyezni, és más helyre kell felhelyezni. Ha hosszú távú monitorozásra van szükség, alkalmazzon OxiMAX oxigénérzékelőket (MAX-A, MAX-AL vagy MAX-N) vagy Oxisensor II® érzékelőket (D-25, D-25L vagy N-25) a beteg korától, testsúlyától és a műszerek kompatibilitásától függően.

Használati utasítás

Ezt az érzékelőt kizárólag Nellcor eszközökkel vagy Nellcor oximetriát tartalmazó eszközökkel vagy olyan eszközökkel használja, amelyekkel engedélyezett a Nellcor érzékelők alkalmazása (Nellcor-kompatibilitás eszközök). Az érzékelőbe Nellcor OxiMAX® technológia van építve. Amikor az érzékelőt OxiMAX technológiával felszerelt eszközhöz kapcsolja, az érzékelő az OxiMAX technológia alkalmazásával további, speciális érzékelőtulajdonságokat képes nyújtani. Érdeklődjön az egyes gyártóknál a meghatározott eszközök és érzékelőmodellek kompatibilitásával és tulajdonságaival kapcsolatban.

A többször használatos érzékelők ugyanazon a helyen maximum 4 órán át használhatók, feltéve, hogy az adott helyen rendszeresen ellenőrzi a bőr állapota és az érzékelők megfelelő elhelyezkedését. Egyénileg változhat, hogy a bőr milyen mértékben tolerálja a felhelyezett érzékelőket, ezért előfordulhat, hogy bizonyos betegeknél gyakrabban kell változtatni az érzékelő helyét.

A DS-100A felhelyezése:

1. Helyezzen egy mutatóujjat a DS-100A érzékelőablakára úgy, hogy az ujjhegy az ütközőnél legyen. **(1)**

www.DataSheet4U.com

2. Ha a köröm túl hosszú, a köröm vége túlnyúlik az ütközőn. **(2)**
3. Nyissa szét az érzékelő hátsó füleit, hogy egyenletes erőt fejthessen ki a tappancsok hossza mentén. Ellenőrizze az érzékelő helyét. Ha a mutatóujjat nem lehet kellőképpen behelyezni, vagy nem áll rendelkezésre, vegyen igénybe egy kisebb ujjat, vagy alkalmazzon OxIMax vagy Oxisensor II oxigénérzékelőt. A DS-100A érzékelőt ne alkalmazza hüvelykujjon vagy lábujjon vagy gyermekkézen- vagy lábon át. **(3)**

Megjegyzés: Amikor kiválasztja az érzékelő helyét, elsősorban olyan végtagot válasszon, amelybe nem helyeztek artériás katétert, vérnyomás-mandzsettákat vagy intravaszkuláris infúziós vezetékeket.

4. Az érzékelőt úgy kell beállítani, hogy kábelt a kézfejen felfelé lehessen elvezetni. **(4)**
5. Csatlakoztassa a DS-100A érzékelőt az oximéterhez, és ellenőrizze a helyes működést az oximéter kezelési útmutatójában leírtak szerint.

Megjegyzés: Ha az érzékelő nem követi megbízhatóan a pulzust, elképzelhető, hogy helytelenül van elhelyezve, vagy az érzékelő számára kiválasztott hely túl vastag vagy túl vékony, vagy mélyen pigmentált, vagy egyéb módon vastagon színezett (különböző felvitt színezés, például körömlakk, festék vagy pigmentáló krém) ahhoz, hogy lehetővé tegye a megfelelő fényátvitelt. Ha a fenti helyzetek valamelyike előáll, helyezze át az érzékelőt vagy válasszon egy másik Nellcor érzékelőt, amelyet más helyen helyezhet el.

Tisztítás

A DS-100A eszköz felszíne 70%-os izopropil alkohollal hasonló oldatokkal tisztítható. Ha alacsony szintű fertőtlenítésre van szükség, alkalmazzon 1:10 hígítású fehérítőszeres oldatot. Ne alkalmazzon hígítatlan fehérítőszereseket (5%~5.25% nátrium-hipokloritot) vagy egyéb, itt nem javasolt tisztítóoldatot, mert az az érzékelő tartós károsodását okozhatja.

FIGYELEM! A csatlakozótűket ne tegye ki a tisztítóoldattal való érintkezésnek, mert az az érzékelő károsodását okozhatja.

Az érzékelő tisztítása vagy fertőtlenítése:

1. Itasson át egy tiszta, száraz gézpárnát a tisztítóoldattal. Törölje át az érzékelő és a kábel összes felületét ezzel a gézpárnával.
2. Itasson át egy másik tiszta, száraz gézpárnát steril, desztillált vízzel. Törölje át az érzékelő és a kábel összes felületét ezzel a gézpárnával.
3. Szárítsa fel az érzékelő és a kábel minden felületét egy tiszta, száraz gézpárnával.

FIGYELEM!

1. Ne sterilizáljon besugárással, gőzzel vagy etilén-dioxiddal. Az ilyen sterilizálás kárt okozhat az érzékelőben.
2. A DS-100A helytelen felhelyezése pontatlan méréseket eredményezhet.

3. Ha a DS-100A készüléket erős fény jelenlétében alkalmazza, pontatlan méréseredményeket kaphat. Ilyen körülmények között az érzékelő helyét borítsa be átlátszatlan anyaggal.
4. Az újrafelhasználható érzékelőket 4 óránként más helyre kell helyezni. Egyénileg változhat, hogy a bőr milyen mértékben tolerálja a felhelyezett érzékelőket, ezért előfordulhat, hogy bizonyos betegeknél gyakrabban kell változtatni az érzékelő helyét. Ha a bőr állapota megváltozik, helyezze át az érzékelőt.
5. Intravaszkuláris festékek vagy külsőleg alkalmazott színezőanyagok (körömlakk, festék vagy pigmentáló krém) pontatlan mérésekhez vezethetnek.
6. A DS-100A elmozdulása a készülék teljesítményét károsan befolyásolja.
7. Ne alkalmazzon ragasztószalagot az érzékelő rögzítésére, illetve ne zárja el azt ragasztószalaggal; a vénás pulzáció pontatlan szaturációmérésekhez vezethet.
8. Mint az orvosi berendezéseknél általában, a kábelek elvezetésénél ügyeljen arra, hogy a beteg ne gabalyodjon beléjük, illetve azok ne okozhassák a beteg megfulladását.
9. MRI-vizsgálatok alatt ne használja a DS-100A eszközt vagy más oximetriás érzékelőket. A vezetett áram égési sérülést okozhat. Továbbá a DS-100A befolyásolhatja az MRI-képet, ugyanakkor az MRI-készülék befolyásolhatja az oximetriás mérések pontosságát.
10. Ne alakítsa át vagy módosítsa a DS-100A készüléket. Az átalakítások és módosítások hatással lehetnek a készülék teljesítményére, illetve a mérések pontosságára.

Ha a fenti tudnivalókkal kapcsolatban kérdése merül fel, lépjen kapcsolatba a Nellcor műszaki szolgáltató osztályával vagy a Nellcor helyi képviselőjével.

www.DataSheet4U.com

Jótállás

A lehetséges jótállással kapcsolatban érdeklődjön a Nellcor technikai szolgáltatásokkal foglalkozó részlegénél vagy a helyi képviselőjénél.

A méréspontossággal kapcsolatos adatok

Ha a készüléket Nellcor megfigyelőeszközökkel együtt használja, a méréspontosságra vonatkozó adatokkal kapcsolatban tanulmányozza a megfigyelőeszközhöz mellékelt adatokat, vagy (az Egyesült Államokban) lépjen kapcsolatba a Nellcor műszaki szolgáltató osztályával. Az Egyesült Államokon kívül forduljon a Nellcor képviselőjéhez.

Ha a készüléket nem Nellcor megfigyelőeszközökkel együtt használja, a méréspontosságra vonatkozó adatokkal kapcsolatban tanulmányozza az adott gyártónak a megfigyelőeszközhöz mellékelt adatait.

Megjegyzés: Az adott készülék kezelési útmutatója tartalmazza az érzékelőnek az adott megfigyelőeszközzel való használatára vonatkozó teljes használati útmutatóját.

Az érzékelő az alábbi egyesült államokbeli szabadalmak illetve külföldi megfelelőik szerint kerül forgalomba: 6 708 049; 6 591 123; és 4 685 464.

© 2005 Nellcor Puritan Bennett Inc. Minden jog fenntartva.

www.DataSheet4U.com

OXIMAX® DS-100A Durasensor

Αισθητήρας οξυγόνου για ενήλικες

Οδηγίες χρήσης

Ενδείξεις/Αντενδείξεις

Ο αισθητήρας οξυγόνου για ενήλικες Nellcor Durasensor, μοντέλο model DS-100A, ενδείκνυται για χρήση όταν απαιτείται συνεχής αναίμακτη παρακολούθηση του κορεσμού του οξυγόνου στο αρτηριακό αίμα και του καρδιακού ρυθμού σε ασθενείς με βάρος μεγαλύτερο των 40 kg.

Ο DS-100A αντενδείκνυται για χρήση σε δραστήριους ασθενείς ή για παρατεταμένη χρήση. Δεν έχει σχεδιαστεί για μακροχρόνια παρακολούθηση. Πρέπει να μετακινείται κάθε 4 ώρες (ή συχνότερα, αν αυτό ενδείκνυται από την κατάσταση της κυκλοφορίας ή/και από την ακεραιότητα του δέρματος) και να επανεφαρμόζεται σε διαφορετικό σημείο. Εάν απαιτείται μακροχρόνια παρακολούθηση, χρησιμοποιήστε έναν αισθητήρα οξυγόνου Oximax (MAX-A, MAX-AL ή MAX-N) ή έναν αισθητήρα Oxisensor II® (D-25, D-25L ή N-25), ανάλογα με την ηλικία και το μέγεθος του ασθενούς, και τη συμβατότητα με τα όργανα.

Οδηγίες χρήσης

Χρησιμοποιείτε αυτόν τον αισθητήρα μόνο με όργανα Nellcor και όργανα που περιέχουν οξύμετρο Nellcor ή με όργανα που διαθέτουν άδεια χρήσης αισθητήρων της Nellcor (όργανα συμβατά με αυτά της Nellcor). Ο σχεδιασμός αυτού του αισθητήρα βασίζεται στην τεχνολογία Oximax® της Nellcor. Όταν συνδεθεί σε όργανο με δυνατότητα Oximax, αυτός ο αισθητήρας χρησιμοποιεί την τεχνολογία Oximax για να παρέχει πρόσθετες λειτουργίες απόδοσης προηγμένου αισθητήρα. Συμβουλευτείτε τον κάθε κατασκευαστή για τις λειτουργίες και τη συμβατότητα συγκεκριμένων οργάνων και μοντέλων αισθητήρων.

Οι επαναχρησιμοποιούμενοι αισθητήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ίδια θέση για μέγιστη διάρκεια 4 ωρών, δεδομένου ότι η περιοχή θα ελέγχεται ανά τακτά διαστήματα ως προς την ακεραιότητα του δέρματος και τη σωστή θέση του αισθητήρα. Επειδή η κατάσταση του δέρματος του κάθε ασθενούς επηρεάζει τη δυνατότητα ανοχής του δέρματος για την τοποθέτηση αισθητήρα, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η συχνότερη αλλαγή θέσης του αισθητήρα σε ορισμένους ασθενείς.

Για να εφαρμόσετε τον DS-100A:

1. Τοποθετήστε ένα δέικτη επάνω από το παράθυρο αισθητήρα του DS-100A, με το άκρο του δακτύλου να έρχεται σε επαφή με το στοπ. **(1)**

2. Εάν το δάκτυλο έχει μεγάλο νύχι, το άκρο του νυχιού πρέπει να εκτείνεται πέρα από το στοπ για το δάκτυλο. **(2)**
3. Ανοίξτε τις πίσω προεξοχές του αισθητήρα, ώστε να πετύχετε ίση δύναμη σε όλο το μήκος των επιθεμάτων. Ελέγξτε τη θέση του αισθητήρα. Εάν δεν μπορεί να τοποθετηθεί σωστά δείκτης ή αν δεν είναι διαθέσιμος, χρησιμοποιήστε τον ωτίτη ή χρησιμοποιήστε αισθητήρα OxiMax ή Oxisensor II. Μη χρησιμοποιείτε τον DS-100A σε αντίχειρα ή σε δάκτυλο του ποδιού ή σε ολόκληρη την παλάμη ή το πέλμα ενός μικρού παιδιού. **(3)**

Σημείωση: Όταν επιλέγετε ένα σημείο εφαρμογής του αισθητήρα, πρέπει να δώσετε προτεραιότητα σε άκρα στα οποία δεν έχει τοποθετηθεί αρτηριακή καθετήρας, περιχειρίδα πίεσης του αίματος ή ενδαγγειακή γραμμή έγχυσης.

4. Ο αισθητήρας πρέπει να τοποθετηθεί με τέτοιο προσανατολισμό, ώστε το καλώδιο να διέρχεται πάνω από το εξωτερικό μέρος της παλάμης. **(4)**
5. Συνδέστε τον DS-100A στο οξύμετρο και επιβεβαιώστε την καλή λειτουργία του όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης του οξύμετρου.

Σημείωση: Αν ο αισθητήρας δε λαμβάνει τις σφύξεις με αξιοπιστία, ενδέχεται να μην είναι σωστά τοποθετημένος—ή το σημείο τοποθέτησης του αισθητήρα ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα μεγάλου πάχους ή ιδιαίτερα κεχρωσμένο ή να φέρει άλλου είδους μεγάλη ποσότητα χρωστικών (π.χ. λόγω εξωτερικής εφαρμογής χρωστικών όπως βερνίκι νυχιών, βαφή ή κρέμες), ώστε να επιτρέπει κατάλληλη μετάδοση του φωτός. Σε οποιαδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις, επανατοποθετήστε τον αισθητήρα ή επιλέξτε έναν εναλλακτικό αισθητήρα Nellcor για χρήση σε άλλο σημείο.

Καθαρισμός

www.DataSheet4U.com

Η επιφάνεια του DS-100A μπορεί να καθαρίζεται με σκουπίσμα με διάλυμα, όπως ισοπροπυλική αλκοόλη 70%. Εάν απαιτείται απολύμανση χαμηλού επιπέδου, χρησιμοποιήστε διάλυμα χλωρίου 1:10. Μη χρησιμοποιείτε αδιάλυτο χλώριο (5%–5,25% υποχλωριώδες νάτριο) ή οποιοδήποτε διάλυμα καθαρισμού άλλο από αυτά που συνιστώνται στο παρόν, γιατί μπορεί να προκληθεί μόνιμη βλάβη στον αισθητήρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην εκθέτετε τις ακίδες των συνδετήρων σε διαλύματα καθαρισμού, αφού έτσι ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στον αισθητήρα.

Για να καθαρίσετε ή να απολυμάνετε τον αισθητήρα:

1. Εμποτίστε μια καθαρή, στεγνή γάζα με το διάλυμα καθαρισμού. Περάστε όλες τις επιφάνειες του αισθητήρα και του καλωδίου με αυτό το επίθεμα γάζας.
2. Εμποτίστε άλλη μια καθαρή, στεγνή γάζα με στείρο ή απεσταγμένο νερό. Περάστε όλες τις επιφάνειες του αισθητήρα και του καλωδίου με αυτό το επίθεμα γάζας.
3. Στεγνώστε τον αισθητήρα και το καλώδιο, περνώντας όλες τις επιφάνειες με ένα καθαρό, στεγνό επίθεμα γάζας.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

1. Μην αποστειρώνετε με ακτινοβολία, ατμό ή οξειδίο του αιθυλενίου. Αυτού του είδους η αποστείρωση ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στον αισθητήρα.
2. Η κακή εφαρμογή του αισθητήρα DS-100A ενδέχεται να οδηγήσει σε εσφαλμένες μετρήσεις.

www.DataSheet4U.com

3. Η χρήση του DS-100A σε χώρο με έντονο φωτισμό ενδέχεται να οδηγήσει σε ανακριβείς μετρήσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, καλύπτετε τον αισθητήρα με ένα αδιαφανές υλικό.
4. Οι επαναχρησιμοποιούμενοι αισθητήρες πρέπει να μετακινούνται σε νέο σημείο τουλάχιστον κάθε 4 ώρες. Επειδή η κατάσταση του δέρματος του κάθε ασθενούς επηρεάζει τη δυνατότητα ανοχής του δέρματος για την τοποθέτηση αισθητήρα, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η συχνότερη αλλαγή θέσης του αισθητήρα σε ορισμένους ασθενείς. Αν αλλάξει η ακεραιότητα του δέρματος, μετακινήστε τον αισθητήρα σε άλλο σημείο.
5. Ενδαγγειακές χρωστικές ή χρώματα που εφαρμόζονται εξωτερικά, όπως βερνίκι για τα νύχια, βαφές ή κρέμα με χρωστικές ουσίες, ενδέχεται να οδηγήσει σε εσφαλμένες μετρήσεις.
6. Η απόδοση του DS-100A υποβιβάζεται σε περίπτωση κίνησης.
7. Μην εφαρμόζετε ταινία για να στερεώσετε τον αισθητήρα ή για να τον διατηρήτε κλειστό. Οι φλεβικές σφύξεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε εσφαλμένες μετρήσεις κορεσμού.
8. Όπως για κάθε ιατρικό εξάρτημα, διευθετήστε προεκτικά τα καλώδια για να μειώσετε την πιθανότητα μπερδέματος ή στραγγαλισμού του ασθενή.
9. Μη χρησιμοποιείτε τον DS-100A ή άλλους οξυμετρικούς αισθητήρες κατά τη διάρκεια σάρωσης με μαγνητικό συντονισμό. Το παρεχόμενο ηλεκτρικό ρεύμα ενδέχεται να προκαλέσει εγκαύματα. Επίσης, ο DS-100A ενδέχεται να επηρεάσει την εικόνα μαγνητικού συντονισμού και η μονάδα μαγνητικού συντονισμού ενδέχεται να επηρεάσει την ακρίβεια των οξυμετρικών μετρήσεων.
10. Μην επεμβαίνετε στον DS-100A και μην τον τροποποιείτε. Οι αλλοιώσεις ή τροποποιήσεις ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση ή την ακρίβεια.

Αν έχετε απορίες σχετικά με αυτές τις πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Nellcor ή με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Nellcor DataSheet4U.com

Εγγύηση

Για να προμηθευτείτε πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, αν υπάρχει, αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Nellcor ή με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Nellcor.

Προδιαγραφές ακριβείας

Για το εύρος των προδιαγραφών ακριβείας κατά τη χρήση με μόνιτορ της Nellcor, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται με το μόνιτορ ή (στις Η.Π.Α.) επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Nellcor. Εκτός των Η.Π.Α., επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Nellcor.

Για το εύρος των προδιαγραφών ακριβείας όταν γίνεται χρήση με μόνιτορ άλλου κατασκευαστή από της Nellcor, συμβουλευτείτε τις πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή αυτού του οργάνου.

Σημείωση: Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του οργάνου για πλήρεις οδηγίες σχετικά με τη χρήση του αισθητήρα με αυτό το μόνιτορ.

Αυτός ο αισθητήρας πωλείται βάσει των παρακάτω αμερικανικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των αντίστοιχων της αλλοδαπής: 6,708,049, 6,591,123 και 4,685,464.

© 2005 Nellcor Puritan Bennett Inc. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.

www.DataSheet4U.com

DS-100A Durasensor

Yetişkinler İçin Oksijen Sensörü

Kullanma Yönergeleri

Endikasyonlar/Kontraendikasyonlar

Nellcor Durasensor yetişkinler için oksijen sensörü, model DS-100A, 40 kg'ın üzerindeki hastalar için sürekli nabız ve invazif olmayan arteryel oksijen satürasyonunun izlenmesi gerektiğinde kullanılır.

DS-100A'nın, aktif hastalarda ya da uzun süreli kullanımı kontraendikedir. Uzun süreli monitorizasyon için tasarlanmamıştır. Her 4 saatte bir (ya da dolaşım ve/veya derinin durumu gerektirdiğinde daha sık) çıkartılmalı ve farklı bir yere yeniden takılmalıdır. Uzun süreli monitorizasyon gerektiğinde hastanın yaşına, boyutuna ve cihaz uyumluluğuna göre OxIMAX oksijen sensörü (MAX-A, MAX-AL ya da MAX-N) ya da Oxisensor II® sensörü (D-25, D-25L ya da N-25) kullanın.

Kullanım talimatları

Bu sensörü yalnızca Nellcor cihazları ve Nellcor oksimetresinin yer aldığı cihazlarla veya Nellcor cihazlarını kullanma lisansı olan cihazlarla (Nellcor uyumlu cihazlar) birlikte kullanın. Bu sensör Nellcor OxIMAX® teknolojisine sahiptir. OxIMAX teknolojisine sahip bir cihaza bağlandığında, bu sensör gelişmiş ek sensör performansı özellikleri sağlamak için OxIMAX teknolojisini kullanır. Belli cihaz ve modellerin özellik ve uyumluluğu için tek tek üreticileri inceleyin.

Tekrar kullanılabilir sensörler, en çok 4 saat aynı bölgede kullanılabilir; sensörlerin cilt uyumluluğu ve doğru konumda bulunmasını sağlamak için bölgenin rutin olarak incelenmesi gerekir. Algılayıcı yerleşimini tolere etmek için tek tek cilt koşulları özelliğini etkilediğinden, bazı hastalarda sensör yerinin daha sık değiştirilmesi gerekebilir.

DS-100A'yı uygulamak için:

1. Bir işaret parmağını, parmağın ucu durdurucunun karşısına gelecek şekilde DS-100A'nın sensör penceresi üzerine yerleştirin. **(1)**
2. Parmak tırnağı uzunsa, tırnağın ucu, parmak durdurucusunun üzerine gelecektir. **(2)**

3. Pedlerin boyunca eşit güç uygulamak için sensörün arka tırnaklarını açın. Sensörün konumunu kontrol edin. Eğer işaret parmağı doğru konumlandırılmıyorsa ya da yoksa, daha küçük bir parmak kullanılabilir. Alternatif olarak bir OxIMAX ya da Oxisensor II oksijen sensörü kullanılabilir. DS-100A'yı el ya da ayak başparmağı üzerinde ya da bir çocuğun elinde ya da ayağında kullanmayın. (3)

Not: Bir sensör sahası seçerken, arteriyel kateter, tansiyon manşonu ya da intravasküler infüzyon hattı olmayan bir kol tercih edilmelidir.

4. Sensör, kablo elin üstüne gelecek şekilde yerleştirilmelidir. (4)
5. DS-100A'yı oksimetreye takın ve oksimetre çalıştırma el kitabında açıklandığı gibi doğru şekilde çalıştırma kontrol edin.

Not: Algılayıcı nabızı gerektiği gibi izlemiyorsa, yanlış yerleştirilmiş olabilir; algılayıcı bölgesi çok kalın; çok koyu pigmentli veya uygun ışık iletimine izin vermek için çok koyu renkli olabilir (örneğin, oje, boya veya pigmentli krem gibi harici kullanılan renklendiriciler). Bu koşullardan biri oluşursa, algılayıcıyı yeniden yerleştirin veya farklı bir bölgede kullanılması için başka bir Nellcor algılayıcısı seçin.

Temizleme

DS-100A, %70 izopropil alkol gibi bir çözeltiyle yüzeyi silinerek temizlenebilir. Eğer düşük seviyeli bir dezenfeksiyon gerekiyorsa, 1:10 ağartıcı çözeltisi kullanın. Sensörde kalıcı hasarlara neden olabileceğinden seyreltilmemiş ağartıcı (%5-5,25 sodyum hipoklorür) ya da burada önerilen dışında herhangi bir temizleme çözeltisi kullanmayın.

DİKKAT: Sensöre zarar verebileceğinden konektör pimlerini, temizleme çözeltisine maruz bırakmayın.

Sensörü temizlemek ya da dezenfekte etmek için:

1. Temiz, kuru bir gazlı bez, temizleme çözeltisini iyice emdirin. Sensör ve kablonun tüm yüzeylerini bu gazlı bezle silin.
2. Başka bir temiz, kuru gazlı bez, steril ya da distile suyu iyice emdirin. Sensör ve kablonun tüm yüzeylerini bu gazlı bezle silin.
3. Tüm yüzeylerini temiz, kuru bir gazlı bezle silerek sensörü ve kabloyu kurutun.

ÖNLEMLER

1. Radyasyon, buhar ya da etilen oksit ile sterilize etmeyin. Bu tür bir sterilizasyon sensöre zarar verebilir.
2. DS-100A algılayıcısının düzgün uygulanmaması yanlış ölçümlere neden olabilir.
3. DS-100A'nın, parlak ışıklar altında kullanılması, yanlış ölçümler yapılmasına neden olabilir. Bu tür durumlarda, sensörü, opak bir malzeme ile kaplayın.
4. Tekrar kullanılabilir sensörler, en az her 4 saatte bir yeni bir sahaya taşınmalıdır. Sensör yerleşimini tolere etmek için tek tek cilt koşulları özelliğini etkilediğinden, bazı hastalarda sensör yerinin daha sık değiştirilmesi gerekebilir. Ciltte bozulmalar meydana geldiğinde sensörü başka bir yere taşıyın.

5. İntravasküler boyalar, oje ya da pigmentli kremler gibi harici renklendirici maddeler, ölçümlerin yanlış olmasına neden olabilir.
6. Hareket edilmesi, DS-100A performansını etkileyebilir.
7. Sensörü yerine sabitlemek ya da kapatmak için bant kullanmayın. Venöz nabız atışları, yanlış saturasyon ölçümlerine neden olabilir.
8. Tüm tıbbi araçlarda olduğu gibi, hastaya dolaşım boğulma tehlikesi oluşturmaması için kabloları özenle yerleştirin.
9. MRI taraması sırasında DS-100A veya başka bir oksimetre sensörü kullanmayın. Kullanılan akım yanıklara neden olabilir. Ayrıca, DS-100A MRI görüntüsünü, MRI birimi de oksimetre ölçümlerinin doğruluğunu etkileyebilir.
10. DS-100A sensörünü değiştirmeyin veya modifiye etmeyin. Her türlü değişiklik ve modifikasyon performans veya doğruluğu etkileyebilir.

Bu bilgiler hakkında sorularınız varsa, Nellcor's Technical Services Department'ı (Nellcor Teknik Servis Departmanı) veya yerel Nellcor temsilcinizi arayın.

Garanti

Bu ürünün, varsa garantisi hakkında bilgi almak için Nellcor Teknik Servis Departmanını veya yerel Nellcor temsilcinizi arayın.

Doğruluk Değerleri

Nellcor monitörleri kullanıldığında doğruluk değer aralığı için gönderilen bilgileri inceleyin veya (ABD'de) Nellcor's Technical Services Department'ına (Nellcor Teknik Servis Departmanı) başvurun. ABD dışında yerel Nellcor temsilcisine başvurun.

Nellcor tarafından üretilmemiş bir monitör ile kullanıldığında doğruluk özellikleri için, o alet için üretici tarafından sağlanan bilgilere başvurun.

Not: Bu sensörün, belirtilen monitör ile kullanılmasıyla ilgili tüm talimatlar için cihazın kullanma kılavuzuna bakın.

Bu algılayıcı, aşağıdaki ABD patentleri veya bunlara eşdeğer diğer ülkelere özgü patentler altında satılır: 6.708.049; 6.591.123; ve 4.685.464.

© 2005 Nellcor Puritan Bennett Inc. Tüm hakları saklıdır.

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

www.DataSheet4U.com

www.DataSheet4U.com

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

www.DataSheet4U.com

www.DataSheet4U.com



www.DataSheet4U.com

Tyco Healthcare Group LP
Nellcor Puritan Bennett Division
Pleasanton, CA USA
1-800-NELLCOR

Authorized Representative
Tyco Healthcare UK LTD
Gosport PO13 0AS, U.K.

www.nellcor.com

tyco
Healthcare

CE
0123

10000647A-0505

www.DataSheet4U.com